EDITO

Toujours soucieux de vous apporter des solutions pratiques, économiques, et diversifiées pour répondre à vos besoins professionnels, nous sommes heureux de vous présenter la gamme MEDIAPI de consommables et d'accessoires consacrés à

l'échographie médicale interventionnelle.

Bien entendu, nous restons très vigilants quant à la qualité du mode de fonctionnement qui nous distingue :

- *Un service d'assistance technique à votre écoute.*
- *Un département Produits pour apporter une solution à vos besoins spécifiques.*
- *Une gestion économique et simplifiée de vos achats par la centralisation annuelle de vos commandes et le cadencement des livraisons en fonction de vos besoins.*
- *Pas d'immobilisation de trésorerie : une facturation par livraison.*
- *Un seul interlocuteur dédié : votre conseiller commercial qui vous accompagne dans toutes vos démarches.*
- *Notre mode de commercialisation par téléphone ne perturbe pas votre activité professionnelle : votre conseiller est à votre écoute au moment choisi par vous.*
- *Maîtrise des délais : plus de 90% de nos produits sont en stock permanent.*
- *L'ensemble de nos activités est à la norme ISO 9001 : 2008.*

Jean-Yves FOSSECAVE
Président

médiapi

7 place Louis Lacombe
18000 BOURGES - France

N° Vert 0 800 298 158

Tél : +33 (0)2 48 50 88 77

Fax : +33 (0)2 48 50 88 79

L'offre globale pour les consommables et les accessoires de l'imagerie médicale

Retrouvez l'ensemble de nos consommables d'imagerie sur le catalogue général MEDIAPI

Tous nos produits sur www.mediapi.com

Votre contact personnalisé, région par région

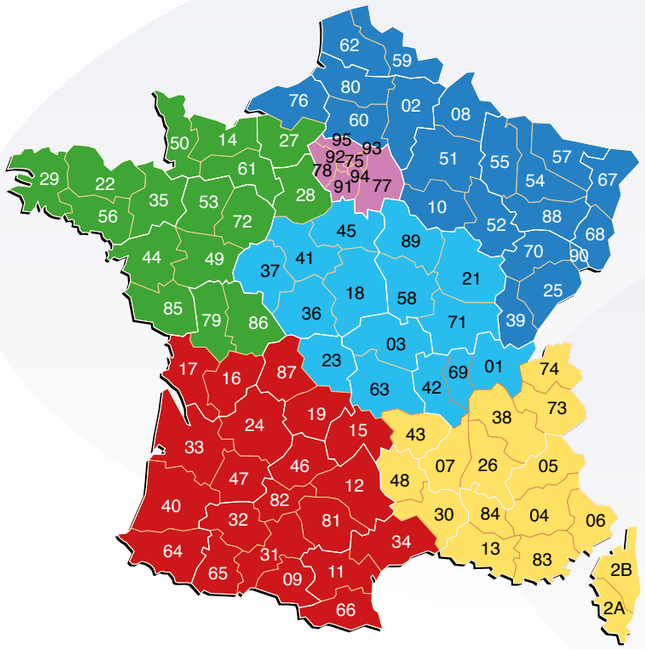

nordest@mediapi.com
NORD-EST : 02 48 50 88 76

ouest@mediapi.com
OUEST : 02 48 50 88 71

centre@mediapi.com
CENTRE : 02 48 50 88 78

parisidf1@mediapi.com
75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95
parisidf2@mediapi.com
75 Rive Droite, 77, 93, 94
ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74

sudest@mediapi.com
SUD-EST : 02 48 50 88 72

sudouest@mediapi.com
SUD-OUEST : 02 48 50 88 70

export@mediapi.com
EXPORT : +33 2 48 66 04 15

domtom@mediapi.com
DOM-TOM : 02 48 66 04 15

Spécialiste des consommables pour l'imagerie médicale

www.mediapi.com

Découvrez toutes les sélections d'accessoires, matériels et consommables médicaux :

- *Radioprotection et Contrôle Qualité* — *Tome 1*
- *Echographie Interventionnelle* — *Tome 2*
- *Imagerie de coupe* — *Tome 3*
- *Imagerie conventionnelle* — *Tome 4*
- *Consommables d'imagerie médicale* — *Tome 5*
- *Gynécologie* — *Tome 6*

Heltis Line

PAPERMED

Profitez de 15 ans d'expérience dans l'imagerie médicale et choisissez la qualité Heltis Line et PAPERMED

Photos non contractuelles, sous réserve de modifications techniques

SOMMAIRE

Tome 2 : ECHOGRAPHIE

GELS D'ECHOGRAPHIE 6
CHAUFFE-GEL D'ECHOGRAPHIE 10
PADS ET MANCHONS COUPLANTS 11
GELS LUBRIFIANTS 15
PROTECTIONS DE SONDE NON STERILES 17
PROTECTIONS DE SONDE STERILES 18
GUIDES AIGUILLES DIRECTOR™ 27
GUIDES AIGUILLES RETROFIT™ 28
GUIDES AIGUILLES SONDES SUPERFICIELLES 29
GUIDES AIGUILLES SONDES ENDOCAVITAIRES 46
GUIDE AIGUILLES PROV-ACCESS 60
BROSSES DE NETTOYAGE POUR GUIDES 61
PISTOLETS POUR BIOPSIE SEMI-AUTOMATIQUES 64
PISTOLETS POUR BIOPSIE AUTOMATIQUES 65
PISTOLETS POUR BIOPSIE DE PROSTATE 66
AIGUILLES COMPATIBLES BARD MAGNUM 67
PISTOLETS DE BIOPSIE POUR HISTOLOGIE 68
HOUSSES STERILES POUR PISTOLETS DE BIOPSIE 70
AIGUILLES POUR CYTOPONCTIONS 72
PISTOLETS CAMECO 73
FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE 74
HOUSSES STERILES POUR TABLETTES 76
HOUSSES STERILES POUR ECHOGRAPHES 77
PROTOCOLE DE DESINFECTION DES SONDES 78
DESINFECTION HAUT NIVEAU - ANIOS 79
BAC DE DESINFECTION POUR SONDES 82
DESINFECTION PAR UV-C - ANTIGERMIX® S1 84
STERILISATEURS - AUTOCLAVES C3 ADVANCE 86
DESINFECTION DES SURFACES 90
HYGIENE DES MAINS 91
DRAPS D'EXAMEN 93
ESSUIE MAINS 94
GANTS D'EXAMEN 97
DIVANS D'EXAMEN 98
REPROGRAPHES 101
PAPIERS THERMIQUES POUR REPROGRAPHES 104
PAPIERS A4-A3 POUR IMPRESSION LASER 105

GELS D'ECHOGRAPHIE

GEL NON STERILE UNIDOSE KONIX™ TURKUAZ

Gel non stérile en présentation unidose de 20 ml pour un usage en échographie externe

- *Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*

Composition :
- *Eau déminéralisée 98,25%*
- *Polymère vinylique 0,6% •Triéthanolamine 0,55%*
- *Mono propylène Glycol 0,5% • Benzyle Alcool 0,1%*

Conditionnement :
- *Foil aluminium ouverture facile 130mm x 70mm - 20 ml*
- *Boîte distributrice de 50 doses de 20 ml*
- *Dimensions de la boîte : L 240 x H 130 x P 80mm - 1,06 kg*

GEL D'ECHOGRAPHIE NON STERILE KONIX™ TURKUAZ		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel non stérile KONIX™ TURKUAZ	Bte distributrice de 50 doses 20 ml	**PMG020NST**

GEL STERILE UNIDOSE KONIX™ TURKUAZ

Gel stérile en présentation unidose de 20 ml pour un usage en échographie invasive ou externe en milieu stérile

- *Double emballage sachet pelable*
- *Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*

Composition :
- *Eau déminéralisée 98,25%*
- *Polymère vinylique 0,6% • Triéthanolamine 0,55%*
- *Mono propylène Glycol 0,5% • Benzyle Alcool 0,1%*

Conditionnement :
- *Sachet pelable stérilisé par irradiation STERILE R*
- *Foil aluminium ouverture facile 130mm x 70mm - 20 ml*
- *Boîte distributrice de 48 doses de 20 ml*
- *Dimensions de la boîte : L 240 x H 205 x P 110 mm - 1,24 kg*

GEL D'ECHOGRAPHIE STERILE KONIX™ TURKUAZ		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel stérile KONX™ TURKUAZ	Bte distributrice de 48 doses 20 ml	**PMG020TK**

GEL STERILE UNIDOSE AQUASONIC™ 100 PARKER

Gel stérile en présentation unidose de 20 ml pour un usage en échographie invasive ou externe en milieu stérile

- *Double emballage sachet pelable*
- *Parfumé et coloré bleu, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*
- *Composition reconnue par les professionnels garantissant une qualité d'image optimale*

Points forts du gel Parker :
- *Adapté à toutes les gammes de fréquences utilisées en échographie*
- *Base aqueuse, ne tache pas les vêtements, n'endommage pas les têtes de sondes*
- *Une formule unique, hypoallergénique, bactériostatique, anallergique et non irritante*

Conditionnement :
- *Sachet pelable stérilisé par irradiation STERILE R*
- *Foil aluminium ouverture facile 130mm x 70mm - 20 ml*
- *Boîte distributrice de 48 doses de 20 ml*
- *Dimensions de la boîte : L 325 x H 95 x P 195 mm - 1,48 kg*

GEL D'ECHOGRAPHIE STERILE AQUASONIC ™ 100 PARKER		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel stérile Aquasonic™ 100 PARKER	Bte distributrice de 48 doses 20 ml	**PMG020PA**

GELS D'ECHOGRAPHIE

GEL NON STERILE 250 ML HELTIS LINE

Gel non stérile en présentation flacon de 250ml pour un usage en échographie externe

Heltis Line

- *Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*
- *Usage possible en échographie 2D et 3D*
- *Sa viscosité permet de réaliser l'examen en condition de confort durable*
- *Bouchon Flip Top pour une fermeture rapide et propre*
- *Permet un usage avec tous types de sondes*

Composition :
- *Eau déminéralisée 98,25% • Polymère vinylique 0,6%*
- *Triéthanolamine 0,55%• Mono propylène Glycol 0,5%*
- *Benzyle Alcool 0,1%*

Conditionnement :
- *Carton de 25 flacons de 250ml avec bouchon Flip Top*
- *Dimensions du carton : L 270 x H 190 x P 270mm - 7,4 kg*

Certificats :
- *CE*
- *Tests dermatologiques*

Retrouvez le gel Heltis Line en cubitainer de 5 litres page 9

GEL D'ECHOGRAPHIE NON STERILE HELTIS LINE			
Désignation	**Conditionnement**	**Fermeture**	**Référence**
Gel d'échographie non stérile HELTIS LINE	Carton de 25 flacons de 250 ml	Bouchon Flip Top	**PMG250TK**

GELS D'ECHOGRAPHIE

GEL NON STERILE 250 ML AQUASONIC™ 100 PARKER

Gel non stérile en présentation flacon de 250 ml pour un usage en échographie externe

- *Parfumé et coloré bleu, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*
- *Composition reconnue par les professionnels garantissant une qualité d'image optimale*
- *Bouchon Mini Flip Top pour une fermeture rapide et propre*
- *Permet un usage avec tous types de sondes*

Points forts du gel Parker :
- *Adapté à toutes les gammes de fréquences utilisées en échographie*
- *Base aqueuse, ne tache pas les vêtements, n'endommage pas les sondes d'échographie*
- *Une formule unique, hypoallergénique, bactériostatique, anallergique et non irritante*

Conditionnement :
- *Carton de 12 flacons de 250ml avec bouchon Mini Flip Top*
- *Dimensions du carton : L 165 x H 185 x P 215mm - 3,6 kg*

Certificat :
CE

Retrouvez le gel Aquasonic ™100 Parker en cubitainer de 5 litres page 9

GEL D'ECHOGRAPHIE NON STERILE AQUASONIC ™ 100 PARKER			
Désignation	**Conditionnement**	**Fermeture**	**Référence**
Gel non stérile Aquasonic™ 100 PARKER	Carton de 12 flacons de 250 ml	Bouchon Mini Flip Top	**PMG250PA**

GELS D'ECHOGRAPHIE

GEL NON STERILE 5L HELTIS LINE

Gel non stérile en présentation cubitainer de 5 litres pour un usage en échographie externe

Heltis Line

- *Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*
- *Sa viscosité permet de réaliser l'examen en condition de confort durable*
- *Bouchon Flip Top pour une fermeture rapide et propre*

Composition :
- *Eau déminéralisée 98,25% • Polymère vinylique 0,6%*
- *Triéthanolamine 0,55%• Mono propylène Glycol 0,5%*
- *Benzyle Alcool 0,1%*

Conditionnement :
- *Cubitainer de 5 litres et un flacon vide 250ml avec bouchon Flip Top*
- *Dimensions du carton : L 210x H 220 x P 170 mm - 5,25 kg*
- *Option : pompe manuelle distributrice*

GEL D'ECHOGRAPHIE NON STERILE HELTIS LINE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel non stérile HELTIS LINE	Cubitainer de 5 litres	**PMG5000TK**
Pompe Manuelle Distributrice	Unité	**PMG5011TK**

GEL NON STERILE 5L AQUASONIC™ 100 PARKER

Gel non stérile en présentation cubitainer 5 litres pour un usage en échographie externe

- *Parfumé et coloré bleu, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes*
- *Composition reconnue par les professionnels garantissant une qualité d'image optimale*
- *Bouchon Mini Flip Top pour une fermeture rapide et propre*

Points forts du gel Parker :
- *Adapté à toutes les gammes de fréquences utilisées en échographie*
- *Base aqueuse, ne tache pas les vêtements, n'endommage pas les capteurs*
- *Une formule unique, hypoallergénique, bactériostatique, anallergique et non irritante*

Conditionnement :
- *Cubitainer de 5 litres*
- *Dimensions du carton : L 210x H 220 x P 170 mm - 5,25 kg*

GEL D'ECHOGRAPHIE NON STERILE AQUASONIC ™ 100 PARKER		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel non stérile Aquasonic™ 100 PARKER	Cubitainer de 5 litres	**PMG5000PA**

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

ACCESSOIRES POUR GELS D'ECHOGRAPHIE

CHAUFFE GEL POUR UN FLACON DE 250 ML

Chauffe gel entièrement automatique pour le réchauffement et le maintien en température d'un flacon de 250ml

- *Equipé d'un thermostat non réglable, le gel est chauffé à une température de 40°C*
- *Le thermostat est couplé à une sécurité évitant toute surchauffe du gel et risque de brûlure du patient*

Données techniques :
- *Capacité : 1 flacon de 250ml*
- *Température unique 40°C*
- *230V - 50Hz*
- *Puissance 20 Watts*
- *Témoin « sous tension »*
- *Matériel garanti 2 ans*
- *Dimensions : 14 x 12 x 21 cm*
- *Poids : 0,9 kg*

CHAUFFE GEL POUR 1 FLACON DE 250 ML	
Désignation	**Référence**
Chauffe gel pour 1 flacon de 250 ml	CGP1000

CHAUFFE GEL POUR 1 A 3 FLACONS DE 250 ML

Chauffe gel entièrement automatique pour le réchauffement et le maintien en température de 1 à 3 flacons de 250 ml

- *Equipé d'un thermostat réglable à trois positions, le gel peut être chauffé à des températures proches de la température du corps*
- *Limité à une température maximale de 46°C, le système évite tout risque de brûlure du patient*
- *Affichage du niveau de température par LED sur la face avant*

Données techniques :
- *Capacité 3 flacons de 250ml*
- *3 Réglages de la température : 35°C - 40°C - 46°C*
- *Affichage Led*
- *230V - 50Hz*
- *Puissance 20 Watts*
- *Témoin « sous tension »*
- *Matériel garanti 2 ans*
- *Dimensions : 24,2 x 12,7 x 22,9 cm*
- *Poids : 1,7 kg*

CHAUFFE GEL POUR 1 À 3 FLACONS DE 250 ML	
Désignation	**Référence**
Chauffe gel pour 1 à 3 flacons de 250 ml	CGP3000

COUPLANTS

PADS COUPLANTS COMPATIBLES TOUTES SONDES

Pad couplant épais pour une parfaite transmission des ondes ultrasoniques

Pad couplant PCS1020

- *Pad couplant épais en polychlorure de vinyle permettant d'assurer une parfaite transmission des ondes ultrasoniques de tous modèles de sondes.*
- *La tête de la sonde d'échographie posée sur le pad couplant permet avec une sonde conventionnelle de réaliser des échographies de surface ou de contact.*
- *La matière de nos pads couplants offre des caractéristiques physiques (viscosité, impédance, absorption sonore) similaires aux tissus humains. L'image permet un rendu optimal, sans risque d'artéfact grâce à une forte conduction sonique (1405 m/s).*
- *Nos pads couplants sont particulièrement recommandés pour un usage avec le **gel d'échographie Heltis Line.***
- *Pour conserver durablement le manchon, utiliser un gel sans colorant ni parfum.*
- *Chaque pad couplant est livré avec sa mallette de rangement individuelle.*
- *Exemples d'applications :*
  - *Diagnostique de la thyroïde*
  - *Diagnostique des glandes mammaires*
  - *Diagnostique des testicules*
  - *Diagnostique pédiatrique*
  - *Diagnostique abdominal*
  - *Médecine du sport et Médecine vétérinaire*
  - *Echographies artérielles*

Pad couplant PCS1040

Données techniques:
- *Matière : Polychlorure de vinyle*
- *Vitesse sonique : 1405 m/s*
- *Absorption : 0,09 dB/MHz x mm*
- *Fluide de contact : Gel d'échographie incolore et inodore*
- *Nettoyage : Eau chaude et savon. Utilisation de désinfectants à base d'alcool possible*
- *Stockage : Dans sa mallette.*
- *Température de stockage : de -10°C à + 30 °C*

Disponible en deux versions :
- *Epaisseur 20mm. Dimensions 100x55 mm*
- *Epaisseur 40mm. Dimensions 105x45 mm*

PADS COUPLANTS COMPATIBLES TOUTES SONDES			
Désignation	**Epaisseur**	**Conditionnement**	**Référence**
Pad couplant compatible toutes sondes	Epaisseur 20 mm	Unité	PCS1020
Pad couplant compatible toutes sondes	Epaisseur 40 mm	Unité	PCS1040

Malette de stockage

COUPLANTS

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES LINEAIRES

Manchon en polychlorure de vinyle permettant d'assurer une parfaite transmission des ondes ultrasoniques de tous modèles de sondes linéaires jusqu'à 85 mm de longueur



Pad couplant PCS2010

Pad couplant PCS2018

Pad couplant PCS2023

- *La tête de la sonde d'échographie est insérée dans le manchon et permet avec une sonde linaire conventionnelle de réaliser des échographies de surface ou de contact.*
- *La matière de nos manchons offre des caractéristiques physiques (viscosité, impédance, absorption sonore) similaires aux tissus humains. L'image permet un rendu optimal, sans risque d'artéfact grâce à une forte conduction sonique (1405 m/s).*
- *Nos manchons sont particulièrement recommandés pour un usage avec le **gel d'échographie Heltis Line**.*
- *Pour conserver durablement le manchon, utiliser un gel sans colorant ni parfum.*
- *Chaque manchon est livré avec sa mallette de rangement individuelle.*
- *Exemples d'applications :*
  - *Diagnostique de la thyroïde*
  - *Diagnostique des glandes mammaires*
  - *Diagnostique des testicules*
  - *Diagnostique pédiatrique*
  - *Diagnostique abdominal*
  - *Médecine du sport et Médecine vétérinaire*
  - *Echographies artérielles*

Données techniques
- *Matière : Polychlorure de vinyle*
- *Vitesse sonique : 1405 m/s*
- *Absorption : 0,09 dB/MHz x mm*
- *Fluide de contact : Gel d'échographie incolore et inodore*
- *Nettoyage : Eau chaude et savon. Utilisation de désinfectants à base d'alcool possible*
- *Stockage : Dans sa mallette.*
- *Température de stockage : de -10°c à + 30 °c*

Disponible en 3 modèles :
- *Epaisseur 10mm. Longueur maxi de la sonde : 70mm*
- *Epaisseur 18mm. Longueur maxi de la sonde : 85mm*
- *Epaisseur 23mm. Longueur maxi de la sonde : 85mm*

Malette de stockage

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES LINEAIRES			
Désignation	**Epaisseur**	**Conditionnement**	**Référence**
Manchon couplant pour sondes linéaires	Epaisseur 10 mm	Unité	**PCS2010**
Manchon couplant pour sondes linéaires	Epaisseur 18 mm	Unité	**PCS2018**
Manchon couplant pour sondes linéaires	Epaisseur 23 mm	Unité	**PCS2023**

COUPLANTS

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES CONVEXES

Manchon en polychlorure de vinyle permettant d'assurer une parfaite transmission des ondes ultrasoniques de tous modèles de sondes convexes

Manchon PCS3010

Manchon PCS3015

- *La tête de la sonde d'échographie est insérée dans le manchon et permet avec une sonde convexe conventionnelle de réaliser des échographies de surface ou de contact.*
- *La matière de nos manchons offre des caractéristiques physiques (viscosité, impédance, absorption sonore) similaires aux tissus humains. L'image permet un rendu optimal, sans risque d'artéfact grâce à une forte conduction sonique (1405 m/s).*
- *Nos manchons sont particulièrement recommandés pour un usage avec le **gel d'échographie Heltis Line**.*
- *Pour conserver durablement le manchon, utiliser un gel sans colorant ni parfum.*
- *Chaque manchon est livré avec sa mallette de rangement individuelle.*
- *Exemples d'applications :*
  - *Diagnostique de la thyroïde*
  - *Diagnostique des glandes mammaires*
  - *Diagnostique des testicules*
  - *Diagnostique pédiatrique*
  - *Diagnostique abdominal*
  - *Médecine du sport et Médecine vétérinaire*
  - *Echographies artérielles*

Données techniques
- *Matière : Polychlorure de vinyle*
- *Vitesse sonique : 1405 m/s*
- *Absorption : 0,09 dB/MHz x mm*
- *Fluide de contact : Gel d'échographie incolore et inodore*
- *Nettoyage : Eau chaude et savon. Utilisation de désinfectants à base d'alcool possible*
- *Stockage : Dans sa mallette.*
- *Température de stockage : de -10°C à + 30 °C*

Disponible en deux versions :
- *Epaisseur 10mm*
- *Epaisseur 15mm*

Malette de stockage

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES CONVEXES			
Désignation	**Epaisseur**	**Conditionnement**	**Référence**
Manchon couplant pour sondes convexes	Epaisseur 10 mm	Unité	**PCS3010**
Manchon couplant pour sondes convexes	Epaisseur 15 mm	Unité	**PCS3015**

COUPLANTS

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES SECTORIELLES

Manchon en polychlorure de vinyle permettant d'assurer une parfaite transmission des ondes ultrasoniques de tous modèles de sondes sectorielles jusqu'à 45 mm de diamètre

Pad couplant PCS4022

Pad couplant PCS4032

Pad couplant PCS4040

Pad couplant PCS4045

- *La tête de la sonde d'échographie est insérée dans le manchon et permet avec une sonde sectorielle de réaliser des échographies de surface ou de contact.*
- *La matière de nos manchons offre des caractéristiques physiques (viscosité, impédance, absorption sonore) similaires aux tissus humains. L'image permet un rendu optimal, sans risque d'artéfact grâce à une forte conduction sonique (1405 m/s).*
- *Nos manchons sont particulièrement recommandés pour un usage avec le **gel d'échographie Heltis Line**.*
- *Pour conserver durablement le manchon, utiliser un gel sans colorant ni parfum.*
- *Chaque manchon est livré avec sa mallette de rangement individuelle.*
- *Exemples d'applications :*
  - *Diagnostique de la thyroïde*
  - *Diagnostique des glandes mammaires*
  - *Diagnostique des testicules*
  - *Diagnostique pédiatrique*
  - *Diagnostique abdominal*
  - *Médecine du sport et Médecine vétérinaire*
  - *Echographies artérielles*

Données techniques
- *Matière : Polychlorure de vinyle*
- *Vitesse sonique : 1405 m/s*
- *Absorption : 0,09 dB/MHz x mm*
- *Fluide de contact : Gel d'échographie incolore et inodore*
- *Nettoyage : Eau chaude et savon. Utilisation de désinfectants à base d'alcool possible*
- *Stockage : Dans sa mallette.*
- *Temparature de stockage : de -10°C à + 30 °C*

Disponible en 4 modèles :
- *Pour sonde diamètre 22 mm*
- *Pour sonde diamètre 32 mm*
- *Pour sonde diamètre 40 mm*
- *Pour sonde diamètre 45 mm*

Malette de stockage

MANCHONS COUPLANTS POUR SONDES SECTORIELLES			
Désignation	**Diamètre**	**Conditionnement**	**Référence**
Manchon couplant pour sondes sectorielles	Diamètre 22 mm	Unité	**PCS4022**
Manchon couplant pour sondes sectorielles	Diamètre 32 mm	Unité	**PCS4032**
Manchon couplant pour sondes sectorielles	Diamètre 40 mm	Unité	**PCS4040**
Manchon couplant pour sondes sectorielles	Diamètre 45 mm	Unité	**PCS4045**

GELS LUBRIFIANTS

GELS LUBRIFIANTS KLY POUR ECHOGRAPHIE INVASIVE

Gels lubrifiants très haute performance, hydrosolubles, conçus pour un usage médical

Tube 42 g ou 82 g

Sachet 5 g

Avec lidocaïne - Sachet 5 g

- *Sa base eau, dépourvue de graisse est non irritante pour la peau, les muqueuses ou les tissus et permet un passage aisé de l'instrumentation médicale sans risque de dégradation.*
- *Depuis 2004, le gel **KLY** est devenu une référence dans le domaine médical et est utilisé dans de nombreux hôpitaux et cliniques en France au travers de notre réseau de distribution médical.*
- *Le gel **KLY** est particulièrement adapté pour les échographies endovaginales ou endorectales. Sa composition à base d'eau élimine tout risque de distorsion, d'atténuation ou d'artéfact sur l'image.*
- ***Recommandations :***
  Dans le cadre d'échographies invasives, la sonde doit préalablement recevoir une désinfection de haut niveau et être pourvue d'une protection de sonde stérile ou non stérile à usage unique en fonction de l'examen pratiqué.
- *Le gel **KLY** est aussi recommandé pour les examens médicaux suivants : l'endoscopie, l'électrothérapie, la cystoscopie, la colonoscopie.*
  Enfin, il peut être utilisé pour les cas de sécheresses vaginales chez la femme lors de l'acte sexuel et garantit une parfaite compatibilité avec les préservatifs en latex.

Composition :
- *Eau déminéralisée • Glycérine naturelle • Hydroxyéthylcellulose*
- *Acide citrique • Conservateurs*

Conditionnements :
- *Le gel KLY est disponible en sachet unidose de 5g ou en tubes de 42g et 82g avec emballage en boîte individuelle.*
- *Contenu stérile jusqu'à ouverture du sachet ou du tube*
- *Code EAN 13 Imprimé sur les boîtes des tubes*

Certifications :
- *CE1014 - Dispositif médical de classe II B*
- *Classe pharmaceutique A13,5 (Hydratants et protecteurs)*

GELS LUBRIFIANTS KLY POUR ECHOGRAPHIE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel lubrifiant KLY - Sachet 5 g	Boîte de 100	**PMGKLYTK05**
Gel lubrifiant KLY avec Lidocaïne - Sachet 5 g	Boîte de 100	**PMGLAS05**
Gel lubrifiant KLY - Tube 42 g	Unité	**PMGKLYTK42**
Gel lubrifiant KLY - Tube 82 g	Unité	**PMGKLYTK82**

GEL LUBRIFIANT STERILE

GEL LUBRIFIANT KLY POUR ECHOGRAPHIE INVASIVE

Gel lubrifiant stérile très haute performance en seringue pré-remplie de 6 ml

- *Sa base eau, dépourvue de graisse, est non irritante pour la peau, les muqueuses ou les tissus et permet un passage aisé de l'instrumentation médicale sans risque de dégradation.*
- *Depuis 2004, le gel **KLY** est devenu une référence dans le domaine médical et est utilisé dans de nombreux hôpitaux et cliniques en France au travers de notre réseau de distribution médical.*
- *Le gel **KLY** est particulièrement adapté pour les échographies endovaginales ou endorectales. Sa composition à base d'eau élimine tout risque de distorsion, d'atténuation ou d'artéfact sur l'image.*
- ***Recommandations :***
  Dans le cadre d'échographies invasives, la sonde doit préalablement recevoir une désinfection de haut niveau et être pourvue d'une protection de sonde stérile ou non stérile à usage unique en fonction de l'examen pratiqué.
- *Le gel **KLY** est aussi recommandé pour les examens médicaux suivants : l'endoscopie, l'électrothérapie, la cystoscopie, la colonoscopie. Enfin, il peut être utilisé pour les cas de sécheresses vaginales chez la femme lors de l'acte sexuel et garantit une parfaite compatibilité avec les préservatifs en latex.*

Composition :
- *Eau déminéralisée • Glycérine naturelle • Hydroxyéthylcellulose*
- *Acide citrique • Conservateurs*

Conditionnement :
Seringue pré-remplie de 6 ml
Code EAN 13 Imprimé sur les boîtes des tubes

Certifications :
- *CE1014 - Dispositif médical de classe II B*
- *Classe pharmaceutique A13,5 (Hydratants et protecteurs)*

GEL LUBRIFIANT STERILE KLY		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gel lubrifiant stérile	Seringue de 6 ml	**PMGKLYSE06**

PROTECTIONS DE SONDE NON STERILES

PROTECTION DE SONDE NON STERILE LATEX 2,0 x 20

Protection de sonde 2,0 x 20 cm non stérile, non lubrifiée, en latex

- *Protections de sondes en latex roulé, non stériles.*
- *Les protections de sondes 2,0 x 20 cm sont spécialement adaptées pour la protection des sondes endocavitaires ou sectorielles de diamètre inférieur à 30 mm.*
- *Pour un diamètre supérieur, nous recommandons l'usage de protections de sondes de dimensions 3,5 x 20 cm.*
- *Non stériles, non lubrifiées et livrées en emballage médicalement propre par 144 pièces sans foil individuel.*

PROTECTION DE SONDE NON STERILE LATEX NON LUBRIFIEE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde latex roulé 2,0 x 20 cm non lubrifiées	Boîte de 144 unités	**PMPS4010**

PROTECTIONS DE SONDE NON STÉRILES LATEX 3,5 x 20

Protections de sonde 3,5 x 20 cm non stériles en latex lubrifiées ou non lubrifiées

PMPS1000 - Lubrifiée

PMPS2000 - Non lubrifiée

- *Protections de sondes en latex roulé, non stériles.*
- *Les protections de sondes 3,5 x 20 cm sont spécialement adaptées pour un usage avec des sondes sectorielles ayant un diamètre supérieur à 30 mm, les sondes superficielles linéaires et convexes.*
- *Non stériles, disponibles non lubrifiées ou lubrifiées et livrées en boîte de 144 pièces avec foil individuel.*

PROTECTIONS DE SONDES NON STERILES LATEX		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde latex roulé 3,5 x 20 cm lubrifiées	Boîte de 144 foils individuels	**PMPS1000**
Protections de sonde latex roulé 3,5 x 20 cm non lubrifiées	Boîte de 144 foils individuels	**PMPS2000**

PROTECTION DE SONDE NON STÉRILE POLYISOPRÈNE 3,5 x 20

Protection de sonde 3,5 x 20 cm non stérile, sans latex, en polyisoprène non lubrifiée

- *Protections de sondes spécialement conçues sans latex afin d'éliminer tout risque d'allergies.*
- *Adaptées pour un usage avec des sondes de petites tailles.*
- *Il est important de préciser que le polyisoprène n'offre pas l'élasticité du latex. Aussi, afin de limiter le risque de rupture de la protection, il est recommandé de n'utiliser ces protections que sur des sondes de petites dimensions telles que les sondes endocavitaires ou sectorielles. Pour des sondes de dimensions plus importantes, nous recommandons l'usage de protections stériles en polyuréthane aux dimensions adaptées.*
- *Compte tenu du risque de rupture de la protection, il convient de réaliser une désinfection de haut niveau de la sonde avant usage sur le patient afin d'éliminer tout risque de contamination croisée.*
- *Non stériles, disponibles non lubrifiées et livrées en boîte de 72 pièces avec foil individuel.*

PROTECTION DE SONDE NON STERILE POLYISOPRENE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde polyisoprène roulé 3,5 x 20 cm non lubrifiées	Boîte de 72 foils individuels	**PMPS1500**

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIÉE STÉRILE 2,0 x 20

Protection de sonde 2,0 x 20cm latex non lubrifiée stérile

- *Protection de sonde en latex roulé très haute densité destinée à protéger durablement et efficacement les sondes invasives afin d'éliminer toute contamination croisée.*
- *Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde.*
- *La protection de sonde stérile 2,0 x 20 cm assure une protection efficace des sondes invasives de diamètres inférieurs à 25 mm de diamètre. Pour les sondes de diamètres supérieurs, préférer une protection de sonde 3,5 x 20 cm.*
- *Lors du positionnement de la protection sur des sondes de diamètres inférieurs à 2 cm, des élastiques de maintien sont fournis dans le blister stérile.*
- *Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.*

PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIEE STERILE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde latex non lubrifiées stériles 2,0 x 20 cm	Boîte de 24 foils individuels	**PMPS3050**

PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIÉE STÉRILE 3,5 x 20

Protection de sonde 3,5 x 20 cm latex non lubrifiée stérile

- *Protection de sonde en latex roulé très haute densité destinée à protéger durablement et efficacement les sondes invasives afin d'éliminer toute contamination croisée.*
- *Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde.*
- *La protection de sonde stérile 3,5 x 20 cm assure une protection efficace des sondes invasives de diamètres supérieurs à 25 mm de diamètre. Pour les sondes de diamètres inférieurs, préférer une protection de sonde 2,0 x 20cm.*
- *Pour un parfait maintien en position de la protection sur des sondes de diamètres inférieurs à 3,5 cm, des élastiques de maintien sont fournis dans le blister stérile.*
- *Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.*

PROTECTION DE SONDE LATEX NON LUBRIFIEE STERILE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde latex non lubrifiées stériles 3,5 x 20 cm	Boîte de 40 foils individuels	**PMPS3100**

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

MODE D'EMPLOI

Protège sonde latex stérile

ETAPE 1 : DESINFECTION HAUT NIVEAU DE LA SONDE

Protocole de désinfection ANIOS

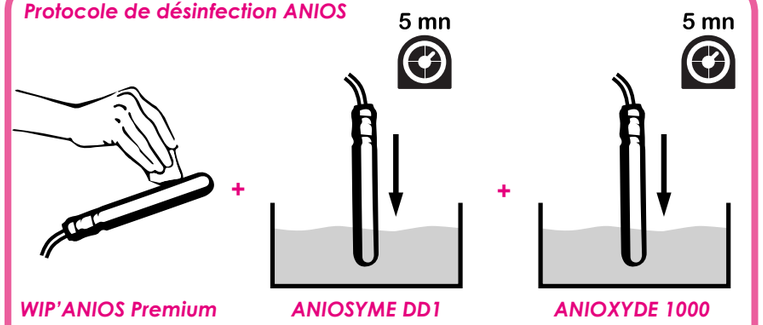

WIP'ANIOS Premium — *ANIOSYME DD1* — *ANIOXYDE 1000*

Procédure détaillée page 78

OU

Désinfection par UV-C avec l'AntiGermix

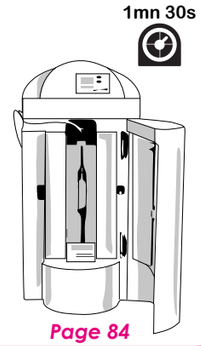

Page 84

ETAPE 2 : MISE EN PLACE DE LA PROTECTION

1. 

2. 

3. 

1. Ouvrir le blister stérile et mettre du gel stérile dans la protection de sonde stérile
2. Dérouler la protection de sonde stérile sur la sonde
3. Assurer le maintien de la protection de sonde avec les élastiques stériles fournis

Une protection de sonde ne sert qu'une seule fois. ***Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.***
La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de dispositifs à usage unique peuvent présenter un risque de contamination croisée, d'infection du patient et / ou de dysfonctionnement du dispositif.
Après usage, jetez les dispositifs médiaux à usage unique dans un conteneur de déchet infectieux.
Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

STERILE EO — *Ne pas réutiliser*

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

PROTECTIONS DE SONDE STERILES PULL UP™ POLYURÉTHANE

Protections de sondes en polyuréthane haute densité destinées à protéger durablement et efficacement les sondes invasives, sectorielles, linéaires et convexes afin d'éliminer toute contamination croisée.

- *Le système PULL UP™ permet une mise en place rapide et sécurisée sur la sonde tout en limitant au mieux le risque de contamination de la protection de sonde lors de la manipulation.*
- *Nos protections en polyuréthane garantissent l'absence de latex et évitent ainsi tout risque de réaction allergique. De plus, le polyuréthane offre un contact particulièrement doux et chaud et permet la réalisation de l'examen dans les conditions de confort les meilleures pour le patient.*
- *Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde.*
- *Nos protections PULL UP™ sont disponibles en longueurs 61cm ou 122cm au choix afin de parfaitement protéger la sonde et le câble. En cas de nécessité, il est possible en option d'ajouter une gaine stérile pour le câble. La gaine stérile pour câble est disponible* ***page 24*** *sous la référence PMPS8000.*
- *Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.*



Rapide et facile à utiliser !

PROTECTIONS DE SONDE SYSTEM PULL UP™ STERILES			
Désignation	**Pliage**	**Conditionnement**	**Référence**
Protection de sonde polyuréthane 14 x 61 cm Stérile + Gel	Système Pull Up™	Boîte distributrice de 24 kits	**PMPS7100**
Protection de sonde polyuréthane 14 x 122 cm Stérile + Gel	Système Pull Up™	Boîte distributrice de 24 kits	**PMPS7200**

Pull Up™ 14x122 cm - Boîte de 24

Pull Up™ 14x61cm - Boîte de 24

STERILE EO

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

MODE D'EMPLOI

Protège sonde polyuréthane stérile avec Système PULL UP™

ETAPE 1 : DESINFECTION HAUT NIVEAU DE LA SONDE

Protocole de désinfection ANIOS

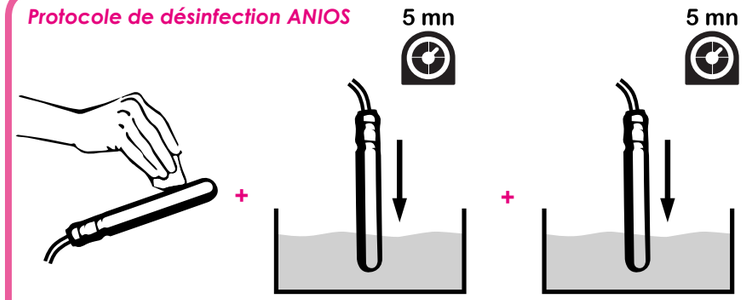

WIP'ANIOS Premium ***ANIOSYME DD1*** ***ANIOXYDE 1000***

Procédure détaillée page 78

OU

Désinfection par UV-C avec l'AntiGermix

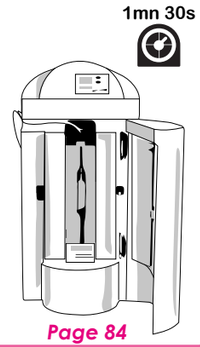

Page 84

ETAPE 2 : MISE EN PLACE DE LA PROTECTION

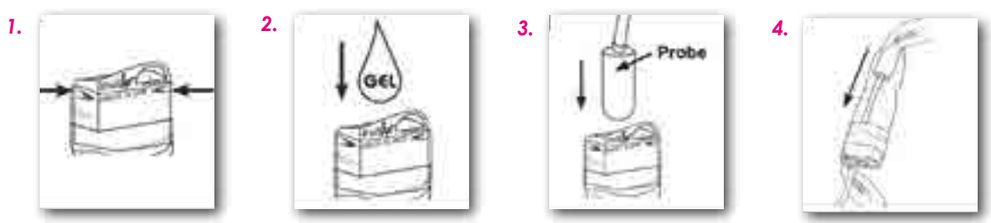

1. ***Ouvrir le blister stérile contenant la protection de sonde et presser les côtés de la protection***
2. ***Mettre du gel stérile dans la protection de sonde stérile***
3. ***Insérer la sonde dans la protection de sonde stérile***
4. ***Tirer la protection de sonde stérile à l'aide du système PULL UP ™ afin de protéger toute la sonde et le câble. Assurer le maintien de la protection de sonde avec les élastiques stériles fournis***
5. ***Mettre du gel stérile entre le patient et la sonde protégée avant de réaliser l'examen***

Une protection de sonde ne sert qu'une seule fois. ***Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.***
La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de dispositifs à usage unique peuvent présenter un risque de contamination croisée, d'infection du patient et / ou de dysfonctionnement du dispositif.
Après usage, jetez les dispositifs médiaux à usage unique dans un conteneur de déchet infectieux.
Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

STERILE EO *Ne pas réutiliser*

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE STANDARD

Protections de sondes en polyuréthane haute densité destinées à protéger durablement et efficacement les sondes invasives, sectorielles, linéaires et convexes afin d'éliminer toute contamination croisée.

- *Nos protections en polyuréthane garantissent l'absence de latex et évitent ainsi tout risque de réaction allergique. De plus, le polyuréthane offre un contact particulièrement doux et chaud et permet la réalisation de l'examen dans les conditions de confort les meilleures pour le patient.*

- *Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde selon le protocole ANIOS* ***page 78.***

- *Nos protections STANDARD sont disponibles en longueur 61cm ou 122cm au choix afin de parfaitement protéger la sonde et le câble. En cas de nécessité, il est possible en option d'ajouter une gaine stérile pour le câble. La gaine stérile pour câble est disponible* ***page 24*** *sous la référence PMPS8000.*

- *Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.*

PROTECTIONS DE SONDE STERILES POLYURETHANE STANDARD			
Désignation	**Pliage**	**Conditionnement**	**Référence**
Protections de sonde polyuréthane Stérile 5 - 13 x 61 cm + gel	Pliage Z	Boîte de 24 kits	**PMPS6050**
Protections de sonde polyuréthane Stérile 9 x 61 cm + gel	Pliage Z	Boîte de 24 kits	**PMPS6000**
Protections de sonde polyuréthane Stérile 14 x 61 cm + gel	Pliage Z	Boîte de 24 kits	**PMPS6100**
Protections de sonde polyuréthane Stérile 18 x 61 cm + gel	Pliage Z	Boîte de 24 kits	**PMPS6150**
Protections de sonde polyuréthane Stérile 14 x 122 cm + gel	Pliage télescopique	Boîte de 24 kits	**PMPS6200**

STERILE EO

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

MODE D'EMPLOI — *Protège sonde polyuréthane stérile STANDARD*

ETAPE 1 : DESINFECTION HAUT NIVEAU DE LA SONDE

Protocole de désinfection ANIOS

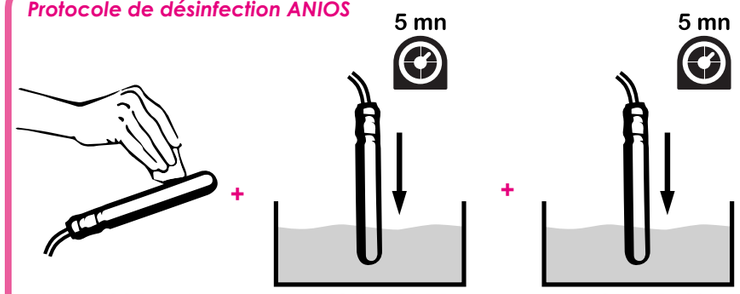

WIP'ANIOS Premium — *ANIOSYME DD1* — *ANIOXYDE 1000*

Procédure détaillée page 78

OU

Désinfection par UV-C avec l'AntiGermix

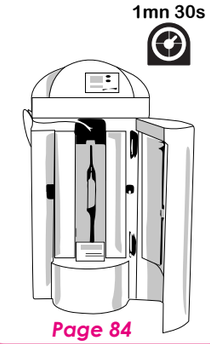

Page 84

ETAPE 2 : MISE EN PLACE DE LA PROTECTION

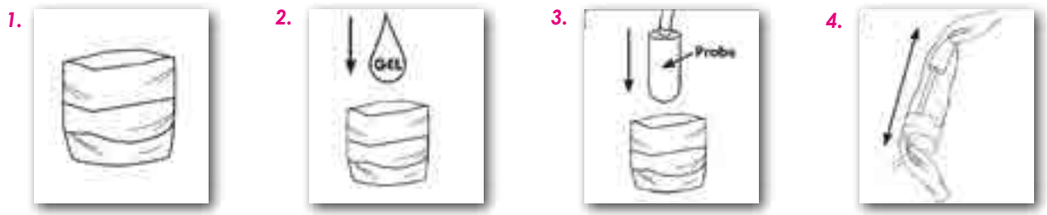

1. ***Ouvrir le blister stérile contenant la protection de sonde et presser les côtés de la protection***
2. ***Mettre du gel stérile dans la protection de sonde stérile***
3. ***Insérer la sonde dans la protection de sonde stérile***
4. ***Tirer la protection de sonde stérile standard afin de protéger toute la sonde et le câble. Assurer le maintien de la protection de sonde avec les élastiques stériles fournis***
5. ***Mettre du gel stérile entre le patient et la sonde protégée avant de réaliser l'examen***

Une protection de sonde ne sert qu'une seule fois. ***Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.***
La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de dispositifs à usage unique peuvent présenter un risque de contamination croisée, d'infection du patient et / ou de dysfonctionnement du dispositif.
Après usage, jetez les dispositifs médiaux à usage unique dans un conteneur de déchet infectieux.
Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

STERILE EO — *Ne pas réutiliser*

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

PROTECTIONS DE SONDES POUR EXAMENS TRANSŒSOPHAGIENS

Kits de procédure stérile ou non stérile complets pour la réalisation des échographies transœsophagiennes.

- *Le kit de procédure permet de réaliser l'examen transœsophagien dans les conditions parfaites d'asepsie et de sécurité pour le patient et le matériel. De plus, la protection de sonde assure une barrière de protection bactériologique pour la sonde et permet une désinfection plus aisée après l'examen.*

- *Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde.*

- *Chaque kit est livré avec le contenu suivant :*

  - *Une protection de sonde avec embout rétréci 2,5 - 4,4 cm x 122cm*
  - *Un jeu de bandes adhésives pour le maintien de la protection sur la sonde*
  - *Un câle dent rigide permettant de protéger la sonde lors de l'insertion dans l'œsophage*
  - *Un sachet de gel stérile Parker Aquasonic*

PROTECTIONS DE SONDES POUR EXAMENS TRANSOESOPHAGIENS		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protection de sonde pour examen transoesophagien - Non stérile	Boîte de 12 kits	**PMPS9000**
Protection de sonde pour examen transoesophagien - Stérile	Boîte de 12 kits	**PMPS9100**

PROTECTION DU CÂBLE DE SONDE D'ECHOGRAPHIE

Pour la protection du câble de la sonde d'échographie

- *Gaine stérile, ouverte à chaque extrémité, pour la protection du câble de la sonde d'échographie.*

- *Dimensions de la protection : 10,2 x 243,8 cm.*

- *Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.*

- *Chaque kit est livré dans un sachet pelable stérile avec le contenu suivant :*
  - *Une protection de câble en polyéthylène*
  - *Un jeu de collier pour maintien de la protection sur le câble d'échographie*

STERILE EO

PROTECTION DU CÂBLE DE SONDE D'ECHOGRAPHIE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protection du câble de sonde d'échographie	Boîte de 24 kits	**PMPS8000**

ECHOGRAPHIE

PROTECTIONS DE SONDE STERILES

PROTECTION DE SONDE STERILE SCANNING COVER

Protection de sonde stérile Scanning Cover pour biopsie mammaire

- *Protection de sonde stérile spécialement conçue pour les biopsies mammaires*
- *Dimensions : 20,3 cm x 30,5 cm*
- *Economique avec sa matière polyéthylène*
- *Conditionnée en sachet pelable stérile par boîte de 100*
- *Stérilisée à l'oxyde d'éthylène*

STERILE EO

PROTECTION DE SONDE STERILE SCANNING COVER		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protection de sonde Stérile SCANNING COVER	Boîte de 100	**PMPS5500**

PROTECTION DE SONDE ECLIPSE ® PARKER

Protections de sondes endocavitaires pré-gélifiées Eclipse® Parker

- *Fourreau à usage unique pour sondes et transducteurs à ultrasons à usage médical, d'une grande douceur, sans latex, pré-gélifié avec du gel de transmission ultrasonique Aquasonic ® 100*
- *Convient à presque tous les types de sondes à ultrasons pour cavité interne*
- *Dispositif médicalement propre*

PROTECTION DE SONDE ECLIPSE® PARKER		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Protection de sonde Parker Eclipse® 64 - 44 x 241 mm + Gel Parker	Carton de 100	**PMPS5000**

PRESENTATION

SETS DE GUIDES AIGUILLES DESTINES AUX PROCEDURES DE BIOPSIE ECHOGUIDEES

• Innovant

Unique dispositif sur le marché permettant de réaliser des biopsies échoguidées.

• Compatible

Une très large gamme de brides "Bracket" permet d'équiper les sondes les plus courantes disponibles sur le marché.

• Economique

Seul le guide aiguille stérile est à usage unique. La bride, protégée par la protection de sonde, est réutilisable.

• Simple

Le guide aiguille stérile est compatible avec l'ensemble de vos brides. Une seule et même référence à commander.

• Multi-applications

Le guide stérile peut être monté sur des sondes superficielles, endocavitaires ou sectorielles équipées de brides.

• Pose du guide en 4 étapes

1. Sonde d'échographie

2. Sonde d'échographie + Bride "Bracket"

3. Sonde d'échographie + Bride + Protection

4. Sonde d'échographie + Bride + Protection + Guide aiguille

GUIDES AIGUILLES DIRECTOR™

GUIDES AIGUILLES DIRECTOR™

Guides aiguilles stériles, à usage unique, sans latex pour les sondes autres que General Electric

- *DIRECTOR™ est un guide aiguille stérile à usage unique pouvant être monté sur l'ensemble des supports guides DIRECTOR ™ montés sur les sondes autres que General Electric.*
- *Le guide DIRECTOR ™ est un accessoire pour sonde de haute précision permettant de guider une aiguille à biopsie ou un cathéter lors du placement et du prélèvement.*
- *DIRECTOR ™ a été spécialement conçu pour garantir la réalisation de biopsies en milieu stérile. En utilisant un support guide DIRECTOR ™, vous réalisez des économies conséquentes car seul le guide aiguille est à usage unique. Son support est lui réutilisable.*
- *Pour équiper votre sonde du bon support guide aiguille à usage unique stérile DIRECTOR™, parcourez notre catalogue de supports ci-après. Si votre sonde n'est pas présente dans notre catalogue, contactez notre service technique au 02 48 50 88 77 ou par e-mail : info@mediapi.com.*
- *Pour les utilisateurs de sondes General Electric, utilisez les Guides Aiguilles RETROFIT™, guides validés par le fabricant.*
- ***Points forts des guides DIRECTOR ™ :***
  - *Système d'attache rapide*
  - *Grande stabilité*
  - *Fermeture sécurisée anti-détachement*
  - *Economique avec support bride réutilisable*
  - *Disponible en 14G; 16G; 18G; 20G; 21G; 23G*
  - *Fenêtre de guidage transparent*
  - *Système de retrait rapide de l'aiguille*
- *DIRECTOR ™ est un dispositif médical stérile sans latex et conditionné en boîte de 24 guides.*

14 G

16 G

18 G

20 G

21 G

23 G

GUIDES AIGUILLES DIRECTOR™		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 14G	Boîte de 24	**DIRECTOR14G**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 16G	Boîte de 24	**DIRECTOR16G**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 18G	Boîte de 24	**DIRECTOR18G**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 20G	Boîte de 24	**DIRECTOR20G**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 21G	Boîte de 24	**DIRECTOR21G**
Guide aiguille DIRECTOR™ - 23G	Boîte de 24	**DIRECTOR23G**

1. Sonde d'échographie

2. Sonde d'échographie + Bride "Bracket"

3. Sonde d'échographie + Bride + Protection

4. Sonde d'échographie + Bride + Protection + Guide aiguille

GUIDES AIGUILLES RETROFIT™ POUR SONDES GE

GUIDES AIGUILLES RETROFIT™ POUR SONDES GE

Guides aiguilles stériles à usage unique pour sondes de marque General Electric

- *RETROFIT™ est un guide aiguille stérile à usage unique exclusif pouvant être monté sur l'ensemble des supports guides RETROFIT™ montés sur les sondes de marque General Electric.*
- *Le guide RETROFIT™ est un accessoire pour sonde de haute précision permettant de guider une aiguille à biopsie ou un cathéter lors du placement et du prélèvement.*
- *RETROFIT™ a été spécialement conçu pour garantir la réalisation de biopsies en milieu stérile. En utilisant un support guide RETROFIT™ vous réalisez des économies conséquentes car seul le guide aiguille est à usage unique. Son support est lui réutilisable.*
- *Pour équiper votre sonde GE du bon support guide aiguille à usage unique stérile RETROFIT™, parcourez notre catalogue de supports ci-après. Si votre sonde n'est pas présente dans notre catalogue, contactez notre service technique au 02 48 50 88 77 ou par e-mail: info@mediapi.com*
- ***Points forts des guides RETROFIT™:***
  - *Brevet exclusif pour sondes GE*
  - *Système d'attache rapide*
  - *Grande stabilité*
  - *Fermeture sécurisée anti-détachement*
  - *Economique avec support bride réutilisable*
  - *Disponible en 14G; 16G; 18G; 20G; 21G; 23G*
  - *Fenêtre de guidage transparente*
  - *Système de retrait rapide de l'aiguille*
- *RETROFIT™ est un dispositif médical stérile sans latex et conditionné en boîte de 24 guides.*

14 G

16 G

18 G

20 G

21 G

23 G

GUIDES AIGUILLES RETROFIT™		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Guide aiguille RETROFIT™ - 14G	Boîte de 24	**RETROFIT14G**
Guide aiguille RETROFIT™ - 16G	Boîte de 24	**RETROFIT16G**
Guide aiguille RETROFIT™ - 18G	Boîte de 24	**RETROFIT18G**
Guide aiguille RETROFIT™ - 20G	Boîte de 24	**RETROFIT20G**
Guide aiguille RETROFIT™ - 21G	Boîte de 24	**RETROFIT21G**
Guide aiguille RETROFIT™ - 23G	Boîte de 24	**RETROFIT23G**

1. Sonde d'échographie

2. Sonde d'échographie + Bride "Bracket"

3. Sonde d'échographie + Bride + Protection

4. Sonde d'échographie + Bride + Protection + Guide aiguille

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ESAOTE

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles ESAOTE

Kit de démarrage pour sondes LA424 & LA435 - Angle fixe 45°

- *1 bracket non stérile réutilisable angle 45°*
- *2 protections de sonde stériles*
- *3 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G avec leurs protections de sondes stériles*
- *2 guides aiguilles stériles Director™ 13G et 23G*

BRAESS001

Kit de démarrage pour sondes LA522E, LA523, LA523E, LA523P & LA532E - Angle fixe 45°

- *1 bracket non stérile réutilisable angle 45°*
- *2 protections de sonde stériles*
- *3 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G avec leurs protections de sondes stériles*
- *2 guide aiguilles stériles Director™ 13G et 23G*

BRAESS002

Kit de démarrage pour sondes CA421, CA430 & CA431 - 2 angles fixes (20° et 30°)

- *1 bracket 20° et 1 bracket 30° réutilisables*
- *2 protections de sonde stériles*
- *3 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G avec leurs protections de sondes stériles*
- *2 guides aiguilles stériles Director™ 13G et 23G*

BRAESS003

Kit de démarrage pour sondes CA621 & CA631 - 2 angles fixes (25° et 35°)

- *1 bracket 25° et 1 bracket 35° réutilisables*
- *2 protections de sonde stériles*
- *3 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G avec leurs protections de sondes stériles*
- *2 guides aiguilles stériles Director™ 13G et 23G*

BRAESS004

Kit de démarrage pour sonde CA123 - Angle fixe 15°

- *1 bracket non stérile réutilisable angle 15°*
- *2 protections de sonde stériles*
- *3 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G avec leurs protections de sondes stériles*
- *2 guides aiguilles stériles Director™ 13G et 23 G*

BRAESS005

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ESAOTE		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes ESAOTE LA424 & LA435	Unité	**BRAESS001**
Sondes ESAOTE LA522E, LA523, LA523E, LA523P & LA532E	Unité	**BRAESS002**
Sondes ESAOTE CA421, CA430 & CA431	Unité	**BRAESS003**
Sondes ESAOTE CA621 & CA631	Unité	**BRAESS004**
Sonde ESAOTE CA123	Unité	**BRAESS005**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde ESAOTE !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles GE HEALTHCARE

Kit de démarrage pour sondes 3.5C, 3.5 CS, 348C
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sonde stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES001

Kit de démarrage pour sondes 7L & 546L
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sonde stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES002

Kit de démarrage pour sonde M7C
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES003

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes GE 3.5C, 3.5 CS, 348C	Unité	**BRAGES001**
Sondes GE 7L & 546L	Unité	**BRAGES002**
Sondes GE M7C	Unité	**BRAGES003**

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE

SONDES SUPERFICIELLES

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles GE HEALTHCARE

Kit de démarrage pour sonde 9L
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES004

Kit de démarrage pour sonde 4C
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES005

Kit de démarrage pour sonde M12L
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES006

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde GE 9L	Unité	**BRAGES004**
Sonde GE 4C	Unité	**BRAGES005**
Sonde GE M12L	Unité	**BRAGES006**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde GE HEALTHCARE !

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles GE HEALTHCARE

Kit de démarrage pour sondes 12L & LA39
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES007

Kit de démarrage pour sondes 12L & LA39
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES008

Kit de démarrage pour sondes 6.5C-RC
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES009

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes GE 12L & LA39, angle fixe	Unité	**BRAGES007**
Sondes GE 12L & LA39, angle réglable	Unité	**BRAGES008**
Sonde GE 6.5C - RC	Unité	**BRAGES009**

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE

SONDES SUPERFICIELLES

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles GE HEALTHCARE

Kit de démarrage pour sondes 4C-RC & 3.8C-RC
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES010

Kit de démarrage pour sondes 7.5L-RC & 7L-RC
Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES011

Kit de démarrage pour sondes 3CRF - Angle réglable
- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *6 protections de sondes stériles*
- *2 jeux de 3 guides stériles Retrofit™ 18G, 20G, 22G*

BRAGES012

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES GE		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes GE 4C-RC & 3.8C-RC	Unité	**BRAGES010**
Sondes GE 7.5L-RC & 7L-RC	Unité	**BRAGES011**
Sonde GE 3CRF	Unité	**BRAGES012**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde GE HEALTHCARE !

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

SONDES SUPERFICIELLES

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES PHILIPS

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles PHILIPS

Kit de démarrage pour sondes C5-2
Angle fixe - Bracket plastique

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRAPHS001

Kit de démarrage pour sondes C7-3
Angle fixe - Bracket Acier inoxydable

- *1 bracket non stérile réutilisable en acier inoxydable, angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRAPHS002

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES PHILIPS		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde PHILIPS C5-2 - Plastique	Unité	**BRAPHS001**
Sonde PHILIPS C7-3 - Inox	Unité	**BRAPHS002**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde PHILIPS !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG - MEDISON

Kit de démarrage pour sondes C2-5ET
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS001

Kit de démarrage pour sondes HL5-12ED
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS003

Kit de démarrage pour sondes 3DC2-6
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS002

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C2-5ET	Unité	**BRASAS001**
Sonde SAMSUNG-MEDISON 3DC2-6	Unité	**BRASAS002**
Sonde SAMSUNG-MEDISON HL5-12ED	Unité	**BRASAS003**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SAMSUNG-MEDISON !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG-MEDISON

Kit de démarrage pour sondes C2-5EP
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS004

Kit de démarrage pour sondes L5-12/40 EP
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS005

Kit de démarrage pour sondes C3-7EP
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22 G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS006

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C2-5EP	Unité	**BRASAS004**
Sonde SAMSUNG-MEDISON L5-12/40 EP	Unité	**BRASAS005**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C3-7EP	Unité	**BRASAS006**

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

SONDES SUPERFICIELLES

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG - MEDISON

Kit de démarrage pour sondes C2-5
Angle fixe - Bracket plastique

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *4 jeux de 6 guides stériles Director™ 16G, 18G, 20G, 22G*
- *24 protections de sondes stériles*

BRASAS007

Kit de démarrage pour sondes C2-5
Angle fixe - Bracket acier inoxydable

- *1 bracket non stérile réutilisable en acier inoxydable, angle fixe*
- *4 jeux de 6 guides stériles Director™ 16G, 18G, 20G, 22G*
- *24 protections de sondes stériles*

BRASAS008

Kit de démarrage pour sondes L5-12/50
Angle réglable

- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *4 jeux de 6 guides stériles Director™ 16G, 18G, 20G, 22 G*
- *24 protections de sondes stériles*

BRASAS009

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C2-5 - Plastique	Unité	**BRASAS007**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C2-5 - Inox	Unité	**BRASAS008**
Sonde SAMSUNG-MEDISON L5-12/50	Unité	**BRASAS009**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SAMSUNG-MEDISON !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG - MEDISON

Kit de démarrage pour sondes L5-13/50
Angle réglable

- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *4 jeux de 6 guides stériles Director™ 16G, 18G, 20G, 22G*
- *24 protections de sondes stériles*

BRASAS010

Kit de démarrage pour sondes SC1-6
Angle réglable

- *1 bracket non stérile réutilisable angle réglable*
- *4 jeux de 6 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G, 25G*
- *24 protections de sondes stériles*

BRASAS011

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON L5-13/50	Unité	**BRASAS010**
Sonde SAMSUNG-MEDISON SC1-6	Unité	**BRASAS011**

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG - MEDISON

Kit de démarrage pour sondes C2-8
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS012

Kit de démarrage pour sondes L5-12/60
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS014

Kit de démarrage pour sondes L3-8, LN5-12/40
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS013

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON C2-8	Unité	**BRASAS012**
Sondes SAMSUNG-MEDISON L3-8, LN5-12/40	Unité	**BRASAS013**
Sonde SAMSUNG-MEDISON L5-12/60	Unité	**BRASAS014**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SAMSUNG-MEDISON !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON

SUPERFICIELLES

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles SAMSUNG - MEDISON

Kit de démarrage pour sondes CN2-8
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS015

Kit de démarrage pour sondes LN5-12, LE5-12
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 8 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRASAS016

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES SAMSUNG-MEDISON		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG-MEDISON CN2-8	Unité	**BRASAS015**
Sondes SAMSUNG-MEDISON LN5-12, LE5-12	Unité	**BRASAS016**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SAMSUNG-MEDISON !

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE SIEMENS ACUSON

SUPERFICIELLES

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde superficielle SIEMENS ACUSON

Kit de démarrage pour sondes 4V1
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 18G, 20G, 22G*

BRASIS001

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE SIEMENS-ACUSON		
Modèle de sonde	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SIEMENS ACUSON 4V1	Unité	**BRASIS001**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SIEMENS ACUSON !

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE TERASON

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde superficielle TERASON

Kit de démarrage pour sondes 4C2-V
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 2 guides aiguilles stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRATE-VES001

Compatible également avec les sondes VERMON CLA3-5 ***page 45***

Consultez les guides Director™ compatibles disponibles en ***page 27***

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE TERASON		
Modèle de sonde	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde TERASON 4C2-V	Unité	**BRATE-VES001**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde TERASON !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ULTRASONIX

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles ULTRASONIX

Kit de démarrage pour sondes L14-5/38 & L9-4/38
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 18G, 20G, 22G*

BRAULS001

Kit de démarrage pour sonde L14-5W/60
Angle fixe
- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 18G, 20G, 22G*

BRAULS002

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ULTRASONIX		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes ULTRASONIX L14-5/38 & L9-4/38	Unité	**BRAULS001**
Sonde ULTRASONIX L14-5W/60	Unité	**BRAULS002**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde ULTRASONIX !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ULTRASONIX

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes superficielles ULTRASONIX

Kit de démarrage pour sondes C5-2/60 & C7-3/50
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 18G, 20G, 22G*

BRAULS003

Kit de démarrage pour sondes C5-2/60-1 & C7-3/50-1
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *6 protections de sondes stériles*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 18G, 20G, 22G*

BRAULS004

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES SUPERFICIELLES ULTRASONIX		
Modèles de sondes	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes ULTRASONIX C5-2/60 & C7-3/50	Unité	**BRAULS003**
Sondes ULTRASONIX C5-2/60 -1 & C7-3/50-1	Unité	**BRAULS004**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde ULTRASONIX !

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE VERMON

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde superficielle VERMON

Kit de démarrage pour sondes CLA 3-5
Angle fixe

- *1 bracket non stérile réutilisable angle fixe*
- *3 jeux de 2 guides stériles Director™ 16G, 18G, 22G et leurs protections de sondes stériles*

BRATE-VES001

Compatible également avec les sondes TERASON 4C2-V page 42

Consultez les guides Director™ compatibles disponibles en page 27

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE SUPERFICIELLE VERMON		
Modèle de sonde	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde VERMON CLA 3-5	Unité	**BRATE-VES001**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde VERMON !

GUIDE AIGUILLE POUR SONDES ENDOCAVITAIRES BK

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sondes endocavitaires BK

REUTILISABLE

Guide-aiguille pour sondes endocavitaires 8667 & 8567S
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 14 G

BRABKE100

Retrouvez la brossette de nettoyage des sondes endocavitaires page 61

GUIDE AIGUILLE POUR SONDES ENDOCAVITAIRES BK			
Modèle de sonde	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde BK 8667 & 8567S	14G	Unité	**BRABKE100**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde BK !

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE GE HEALTHCARE

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire GE HEALTHCARE

REUTILISABLE

Guide aiguile pour sonde endocavitaire E7C-RC
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 16 G

BRAGEE110

Retrouvez la brossette de nettoyage des sondes endocavitaires page 61

GUIDE AIGUILLE POUR SONDES ENDOCAVITAIRES GE HEALTHCARE			
Modèle de sonde	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde GE E7C-RC	16G	Unité	**BRAGEE110**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde GE HEALTHCARE !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES GE HEALTHCARE

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires GE HEALTHCARE

USAGE UNIQUE

Guide aiguilles pour sondes endocavitaires
E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H
Usage unique, 16G
Boîte de 24 unités

BRAGEE215

REUTILISABLE

Guide aiguilles pour sondes endocavitaires
E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 14 G

BRAGEE200

Retrouvez la brossette de nettoyage des sondes endocavitaires *page 61*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES GE HEALTHCARE			
Modèles de sondes	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes GE E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H	16G	Boîte de 24 unités	**BRAGEE215**
Sondes GE E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H	14G	Unité	**BRAGEE200**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde GE HEALTHCARE !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES HITACHI - ALOKA

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires HITACHI - ALOKA

REUTILISABLE

Guides aiguilles <u>longs</u> pour sondes endocavitaires
EUP-V33, V33W & V53W
Réutilisables, Guides aiguilles en acier inoxydable, 14G et 16G

BRAHIE100/BRAHIE110

REUTILISABLE

Guides aiguilles <u>courts</u> pour sondes endocavitaires
EUP-V33, V33W, V53W & CC531
Réutilisables, Guides aiguilles en acier inoxydable, 14G et 16G

BRAHIE200/BRAHIE210

Retrouvez la brossette de nettoyage des sondes endocavitaires *page 61*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES HITACHI-ALOKA			
Modèles de sondes	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sondes HITACHI EUP-V33, V33W & V53W - Longs	14G	Unité	**BRAHIE100**
Sondes HITACHI EUP-V33, V33W & V53W - Longs	16G	Unité	**BRAHIE110**
Sondes HITACHI EUP-V33, V33W, V53W & CC531 - Courts	14G	Unité	**BRAHIE200**
Sondes HITACHI EUP-V33, V33W, V53W & CC531 - Courts	16G	Unité	**BRAHIE210**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde HITACHI-ALOKA !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES PHILIPS

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires PHILIPS

REUTILISABLE

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires
Philips-ATL C9-5 ICT, C9-5ec, 9-5 Endo8
Réutilisables, Guides aiguilles en acier inoxydable, 14G et 16G

BRAPHE100/BRAPHE110

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire
Philips-ATL C9-4ec
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 16G

BRAPHE210

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES PHILIPS			
Modèles de sondes	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde PHILIPS-ATL C9-5 ICT, C9-5ec, 9-5 Endo8	14G	Unité	**BRAPHE100**
Sonde PHILIPS-ATL C9-5 ICT, C9-5ec, 9-5 Endo8	16G	Unité	**BRAPHE110**
Sonde PHILIPS ATL C9-4ec	16G	Unité	**BRAPHE210**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde PHILIPS !

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE PROSONIC

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire PROSONIC

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire EC10R
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 16 G

BRAPRE110

Retrouvez la brossette de nettoyage des sondes endocavitaires page 61

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE PROSONIC			
Modèle de sonde	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde PROSONIC EC10R	16G	Unité	**BRAPRE110**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde PROSONIC !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SAMSUNG -MEDISON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires SAMSUNG-MEDISON

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sondes endocavitaires EC4-9ES & EC4-9IS
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 14G et 16 G

BRASAE100/BRASAE110

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire EC4-9-10ED
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable, 16 G

BRASAE210

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SAMSUNG - MEDISON			
Modèles de sondes	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SAMSUNG - MEDISON EC4-9ES et EC4-9IS	14G	Unité	**BRASAE100**
Sonde SAMSUNG - MEDISON EC4-9ES et EC4-9IS	16G	Unité	**BRASAE110**
Sonde SAMSUNG - MEDISON EC4-9-10ED	16G	Unité	**BRASAE210**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SAMSUNG-MEDISON !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SHIMADZU

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires SHIMADZU

REUTILISABLE

Guides aiguilles pour sonde endocavitaire UB10R-065U
Réutilisables, Guides aiguilles en acier inoxydable 14G et 16G

BRASHE100/BRASHE110

Guides aiguilles pour sonde endocavitaire TV11R-055U

BRASHE200	*Réutilisable, acier inox 14 G*
BRASHE210	*Réutilisable, acier inox 16 G*
BRASHE215	*Stérile, à usage unique 16 G, Bte 24*

Guides aiguilles pour sonde endocavitaire EC11R-055U

BRASHE310	*Réutilisable, acier inox 16 G*
BRASHE315	*Stérile, à usage unique 16 G, Bte 24*

REUTILISABLE

USAGE UNIQUE

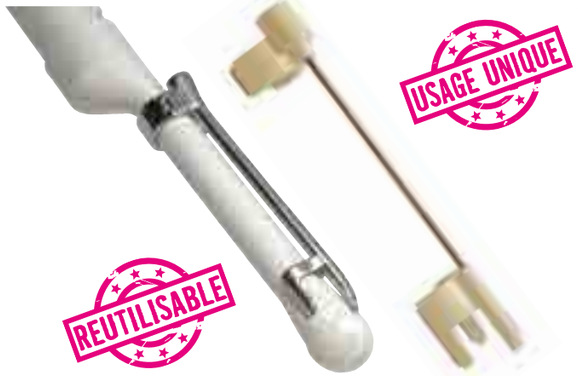

REUTILISABLE

USAGE UNIQUE

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SHIMADZU				
Modèles de sondes	**Utilisation**	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SHIMADZU UB10R-065U	Réutilisable Inox	14G	Unité	**BRASHE100**
Sonde SHIMADZU UB10R-065U	Réutilisable Inox	16G	Unité	**BRASHE110**
Sonde SHIMADZU TV11R-055U	Réutilisable Inox	14G	Unité	**BRASHE200**
Sonde SHIMADZU TV11R-055U	Réutilisable Inox	16G	Unité	**BRASHE210**
Sonde SHIMADZU TV11R-055U	Stérile, à usage unique	16G	Boîte de 24 unités	**BRASHE215**
Sonde SHIMADZU EC11R-055U	Réutilisable Inox	16G	Unité	**BRASHE310**
Sonde SHIMADZU EC11R-055U	Stérile, à usage unique	16G	Boîte de 24 unités	**BRASHE315**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SHIMADZU !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SIEMENS-ACUSON

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sondes endocavitaires SIEMENS-ACUSON

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sondes endocavitaires EC-10C5 & EC7
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 14 G

BRASIE100

Guide aiguille pour sonde endocavitaire EC-9-4
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 14 G

BRASIE200

REUTILISABLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire P2
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 14 G

BRASIE300

REUTILISABLE

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SIEMENS- ACUSON			
Modèles de sondes	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SIEMENS-ACUSON EC-10C5 & EC7	14G	Unité	**BRASIE100**
Sonde SIEMENS EC-9-4	14G	Unité	**BRASIE200**
Sonde SIEMENS P2	14G	Unité	**BRASIE300**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SIEMENS-ACUSON !

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES SONOSITE ET TOSHIBA

GUIDES AIGUILLES

Guides aiguilles pour sonde endocavitaire SONOSITE

REUTILISABLE

Guides aiguilles pour sonde endocavitaire C8 Series
Réutilisables, Guides aiguilles en acier inoxydable 14G et 16G

BRASOE100/BRASOE110

GUIDES AIGUILLES POUR SONDE ENDOCAVITAIRE SONOSITE			
Modèle de sonde	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde SONOSITE C8 Series	14G	Unité	**BRASOE100**
Sonde SONOSITE C8 Series	16G	Unité	**BRASOE110**

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire TOSHIBA

USAGE UNIQUE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire PVM-651VT
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 14G

BRATOE100

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE TOSHIBA			
Modèle de sonde	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Sonde TOSHIBA PVM-651VT	14G	Unité	**BRATOE100**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde SONOSITE ou TOSHIBA !

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES ULTRASONIX ET ZONARE

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire ULTRASONIX

Guide aiguille pour sonde endocavitaire EC9-5/10
Réutilisable, Guide aiguille en acier inoxydable 16G

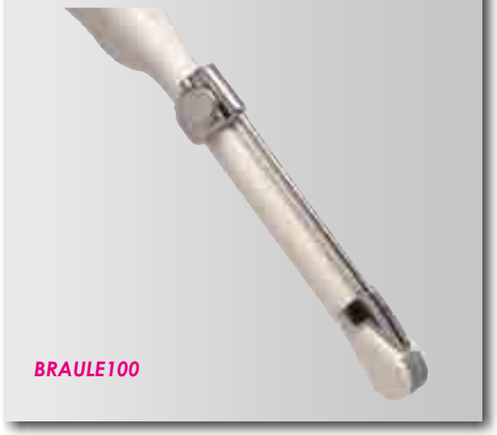

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE ULTRASONIX			
Modèle de sonde	Gauge	Conditionnement	Référence
Sonde ULTRASONIX EC9-5/10	16G	Unité	**BRAULE110**

GUIDE AIGUILLE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire ZONARE

Guide aiguille pour sonde endocavitaire E9-4
Usage unique, 16 G Boîte de 24

GUIDE AIGUILLE POUR SONDE ENDOCAVITAIRE ZONARE			
Modèle de sonde	Gauge	Conditionnement	Référence
Sonde ZONARE E9-4	16G	Boîte de 24 unités	**BRAZOE110**

Consultez-nous pour tout autre modèle de sonde ULTRASONIX ou ZONARE !

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES

SONDES ENDOCAVITAIRES

NOUVEAUX GUIDES AIGUILLES DE PRECISION

Modèle SAPPHIRE

Guide aiguille SAPPHIRE compatible

- *SAMSUNG-MEDISON*
- *PHILIPS*

- *SAMSUNG-MEDISON : EV4-9/10ED, ER4-9/10ED, EC4-9, EV N4-9, EV4-9, ER4-9*
- *PHILIPS C9-4EC*

GUIDE AIGUILLE MODELE SAPPHIRE			
Désignation	Gauge	Conditionnement	Référence
Guide aiguille SAPPHIRE Usage Unique	16G	Boîte de 24 unités	**BRAGUE110**

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES

NOUVEAUX GUIDES AIGUILLES DE PRECISION

Modèle AQUAMARINE

- *ESAOTE : EC123, TRT12,VT12*
- *PHILIPS E6509*
- *GE IC5-9-RS*
- *SAMSUNG MEDISON BCC4-9*
- *PIE MEDICAL C7-4R8TRD*
- *SIEMENS BE9-4*
- *TERASON 8EC4*

GUIDE AIGUILLE MODELE AQUAMARINE			
Désignation	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Guide aiguille AQUAMARINE Usage Unique	16G	Boîte de 24 unités	**BRAGUE210**

GUIDES AIGUILLES POUR SONDES ENDOCAVITAIRES

NOUVEAUX GUIDES AIGUILLES DE PRECISION

Modèle EMERALD

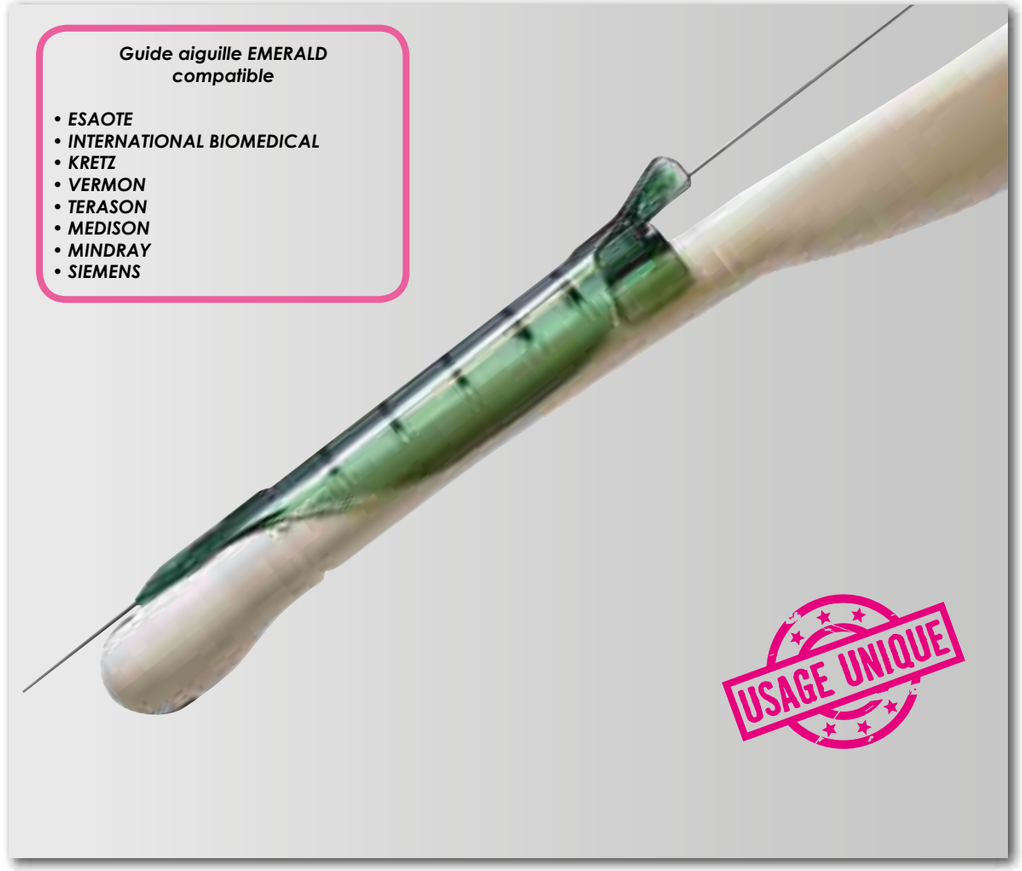

- *ESAOTE E8-5 R10*
- *INTERNATIONAL BIOMEDICAL E 71*
- *KRETZ PB-ER4-9ES*
- *VERMON E 710*
- *TERASON 8EC4(V)*
- *MEDISON : EC4-9IS, EC4-9Es, ER4-9ES, 10R EV/140D*
- *MINDRAY : EV6.5 M HZ/R10, 6CV1S*
- *SIEMENS : 6.5 EC10, EC7, EC9-4 (SONOLINE G20, G50S, ACUSON X500 ULTRASOUND SYSTEMS), EV9-4 (ACUSON X500 ULTRASOUND SYSTEM)*

GUIDE AIGUILLE MODELE EMERALD			
Désignation	**Gauge**	**Conditionnement**	**Référence**
Guide aiguille EMERALD Usage Unique	16G	Boîte de 24 unités	**BRAGUE310**

GUIDES AIGUILLES PROV-ACCESS™

GUIDES AIGUILLES PROV-ACCESS™

Guides aiguilles stériles, à usage unique, sans latex pour sondes de marque BARD Site Rite

- *ProV-ACCESS ™ est un guide cathéter stérile à usage unique spécifiquement conçu pour être monté sur les sondes vasculaires BARD Site Rite™.*
- *Le guide ProV-ACCESS ™ est un accessoire de haute précision permettant le placement de l'aiguille introductrice du cathéter au point d'introduction à l'aide d'échographes vasculaires BARD Site Rite™.*
- *ProV-ACCESS ™ a été spécialement conçu pour garantir la réalisation de l'échoguidage du cathéter en conservant l'environnement stérile.*
- ***Points forts des guides ProV-ACCESS ™***
  - *Compatible avec les aiguilles introductrices de 18G à 21G*
  - *Brevet exclusif pour sondes Bard Site Rite*
  - *Système d'attache rapide*
  - *Grande stabilité et précision*
  - *Fermeture sécurisée anti-détachement*
  - *Fenêtre de guidage transparente*
- *ProV-ACCESS ™ est un dispositif médical stérile sans latex et conditionné en boîte de 10 kits.*

GUIDES AIGUILLES PROV-ACCESS™

Désignation	Profondeur	Conditionnement	Référence
Kit guides aiguilles stériles PROV-ACCESS™	1,0 cm - 1,5 cm - 2,0 cm	Boîte de 10	**PROV001**
Kit guides aiguilles stériles PROV-ACCESS™	1,0 cm - 1,5 cm - 3,5 cm	Boîte de 10	**PROV002**

1,0 cm

1,5 cm

2,0 cm

3,5 cm

ACCESSOIRE POUR GUIDES AIGUILLES

BROSSES DE NETTOYAGE

Brosses pour le nettoyage des guides aiguilles

- *Pour un parfait nettoyage des guides aiguilles réutilisables en acier inoxydable*
- *Usage unique, stériles*
- *Pack de 5 brosses*

BROSSES DE NETTOYAGE DES SONDES ENDOCAVITAIRES

Désignation	Conditionnement	Référence
Brosses de nettoyage des guides aiguilles en acier inoxydable	Pack de 5 brosses	**BRAACC100**

NOTES

PROTEK
MEDICAL PRODUCTS, INC.

MADE IN USA

Design, Develop & Manufacture

Quality ultrasound and imaging products. Providing our customers with quality products that protect patients, medical personnel, and prolong equipment life. Protek remains committed to inventing and developing new devices always focusing on patient care and the applications for healthcare professionals.

Certificates of Quality

- ISO 13485 Certified
- CE Certified
- Japan Certified
- KFDA Certified
- TGA Certified

New products are continually being released. View our complete line of products at www.protekmedical.com

Product Development
Protek has many years of expertise designing and developing ultrasound needle guides, probe covers, instrument drapes and imaging accessories. With patented technologies, we provide a solid foundation for our customers to realize prompt market release.

Manufacturing
Protek is the manufacturer; producing, processing and packaging sterile or non-sterile medical devices in certified Cleanrooms. Proven quality, Protek is committed to user and patient safety. The Protek team is proud to practice FDA, ISO, MDD, MHLW, and other global regulatory standards recognized in the medical industry.

Needle Guides
Disposable and reusable needle guides are designed for endocavity or general purpose biopsy procedures, ensuring quick and precise needle placement.

Probe Covers & Instrument Covers
Protek's probe covers and instrument drapes provide a shield against cross contamination while assisting in the care and protection of your equipment.

Kit Building
Custom packaging, private labeling and sterilization; allows for multiple options.

PROTEK MEDICAL PRODUCTS, INC. | **Contact Us for Additional Order Information:**
4125 Windsor Court, Coralville, IA 52241, USA | Phone: (319)545-7100
Fax: (319)545-7099 | E-mail: sales@protekmedical.com | Web: www.protekmedical.com

© 2013 Protek Medical Products, Inc.

PISTOLETS POUR BIOPSIE TISSUS MOUS

PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUES STERICUT

Pistolets de biopsie semi automatiques servant au prélèvement d'échantillons de tissus histologiques

Semi-automatique

TSK Laboratory EUROPE BV

- *STERICUT est un pistolet de biopsie semi automatique à usage unique de très haute précision.*
- *Le modèle STERICUT permet une approche manuelle de l'aiguille vers la zone à biopsier.*
- *Le déclenchement avec le pouce, par l'arrière du pistolet, permet d'assurer un prélèvement précis de 11mm ou 22mm réglable par l'utilisateur lors de l'armement.*
- *Dispositif de sécurité anti-déclenchement inclus.*
- *La gamme STERICUT est équipée d'une aiguille échogène spécialement conçue pour un guidage avec ultrason et propose un large choix d'aiguilles de 14G à 20G avec des longueurs de 90 mm ou 130 mm. D'autres longueurs sont disponibles sur demande. Longueur maxi. de la gamme : 220 mm.*
- *Chaque pistolet de ponction est à usage unique stérile et conditionné en sachet individuel par boîte de 10.*
- *Disponible également avec aspiration*

PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES STERICUT		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Pistolet semi-automatique STERICUT 14G - Long 90 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE14G090**
Pistolet semi-automatique STERICUT 14G - Long 130 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE14G130**
Pistolet semi-automatique STERICUT 16G - Long 90 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE16G090**
Pistolet semi-automatique STERICUT 16G - Long 130 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE16G130**
Pistolet semi-automatique STERICUT 18G - Long 90 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE18G090**
Pistolet semi-automatique STERICUT 18G - Long 130 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE18G130**
Pistolet semi-automatique STERICUT 18G - Long 160 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE18G160**
Pistolet semi-automatique STERICUT 18G - Long 200 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE18G200**
Pistolet semi-automatique STERICUT 20G - Long 90 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE20G090**
Pistolet semi-automatique STERICUT 20G - Long 130 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE20G130**
Pistolet semi-automatique STERICUT 20G - Long 220 mm - Projection 10/20 mm	Boîte de 10	**STE20G220**

PISTOLETS POUR BIOPSIE TISSUS MOUS

PISTOLETS AUTOMATIQUES ACECUT

Pistolets de biopsie automatiques servant au prélèvement d'échantillons de tissus histologiques

Automatique

TSK Laboratory EUROPE BV

- *Le système d'amorce est rapide grâce au système Levé-Armé du pistolet.*
- *Le déclenchement et le prélèvement simultané sont contrôlés par le biais du poussoir FIRE situé à l'arrière du pistolet.*
- *De série, une position intermédiaire permet de réaliser le déclenchement en 2 temps (pénétration-prélèvement).*
- *Dispositif de sécurité anti-déclenchement inclus.*
- *La gamme ACECUT a été spécialement conçue pour un guidage avec ultrason, Rayon X ou CT et propose un large choix d'aiguilles spécifiques de 11G/14G/16G/18G avec des longueurs de 75 mm, 115 mm et 150 mm.*
- *Chaque pistolet de ponction est à usage unique stérile et conditionné en sachet individuel par boîte de 10.*

PISTOLETS AUTOMATIQUES ACECUT		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Pistolet ACECUT automatique 11G - Long 75 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE11G075**
Pistolet ACECUT automatique 11G - Long 115 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE11G115**
Pistolet ACECUT automatique 11G - Long 150 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE11G150**
Pistolet ACECUT automatique 14G - Long 75 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE14G075**
Pistolet ACECUT automatique 14G - Long 115 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE14G115**
Pistolet ACECUT automatique 14G - Long 150 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE14G150**
Pistolet ACECUT automatique 16G - Long 75 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE16G075**
Pistolet ACECUT automatique 16G - Long 115 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE16G115**
Pistolet ACECUT automatique 16G - Long 150 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE16G150**
Pistolet ACECUT automatique 18G - Long 75 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE18G075**
Pistolet ACECUT automatique 18G - Long 115 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE18G115**
Pistolet ACECUT automatique 18G - Long 150 mm - Projection 22 mm	Boîte de 10	**ACE18G150**

PISTOLETS POUR BIOPSIE DE LA PROSTATE

PISTOLETS AUTOMATIQUES PRIMECUT

Pistolets de biopsie automatiques servant au prélèvement de tissus mous de la prostate

Dédié Prostate

TSK Laboratory EUROPE BV

- *PRIMECUT PROSTATE est un pistolet automatique dédié au prélèvement d'échantillons de tissus mous de la prostate.*
- *L'aiguille reçoit un traitement spécial afin de réaliser jusqu'à 15 prélèvements.*
- *Le système d'amorce est rapide grâce au système double poussoirs du pistolet.*
- *Le déclenchement et le prélèvement simultané sont contrôlés par le biais du poussoir situé sur le côté du pistolet et se manipulent simplement avec le pouce.*
- *La gamme PRIMECUT PROSTATE a été spécialement conçue pour la biopsie de la prostate avec un guidage avec ultrason et propose un choix d'aiguilles en 18G avec des longueurs de 150 mm, 200 mm et 250 mm.*
- *La pénétration et le prélèvement sont de 22 mm.*
- *Chaque pistolet de ponction est à usage unique stérile et conditionné en sachet individuel par boîte de 10 unités.*

PISTOLETS AUTOMATIQUES PRIMECUT		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Pistolet automatique PRIMECUT Prostate 18G - Long 150 mm	Boîte de 10	**PRI18G150**
Pistolet automatique PRIMECUT Prostate 18G - Long 200mm	Boîte de 10	**PRI18G200**
Pistolet automatique PRIMECUT Prostate 18G - Long 250 mm	Boîte de 10	**PRI18G250**

AIGUILLES COMPATIBLES BARD MAGNUM

AIGUILLES TOPCUT

Aiguilles TOPCUT compatibles pour pistolets réutilisables Bard Magnum

Economique

TSK Laboratory EUROPE BV

- *L'aiguille TOPCUT est un compatible spécifique au pistolet BARD MAGNUM.*
- *Aiguille avec traitement Echogène pour le guidage ultrason.*
- *S'utilise aussi en radiographie et au scanner.*
- *Disponible de 14G à 20G en longueur 100 mm et 160 mm*
- *L'aiguille TOPCUT est conditionnée en sachet individuel par boîte de 10 unités.*
- *Dispositif compatible économique*

AIGUILLES TOPCUT COMPATIBLES BARD MAGNUM		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 14G (2,0 mm) - Long. 100 mm	Boîte de 10	**TOP14G100**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 14G (2,0 mm) - Long. 160 mm	Boîte de 10	**TOP14G160**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 16G (1,6 mm) - Long. 100 mm	Boîte de 10	**TOP16G100**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 16G (1,6 mm) - Long. 160 mm	Boîte de 10	**TOP16G160**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 18G (1,2 mm) - Long. 100 mm	Boîte de 10	**TOP18G100**
Aiguille TOPCUT compatible Bard Magnum 14G (1,2 mm) - Long. 160 mm	Boîte de 10	**TOP18G160**

PISTOLET DE BIOPSIE POUR HISTOLOGIE

PISTOLET DE BIOPSIE PRO-MAG ™ ULTRA

Pistolet de biopsie Pro-Mag™ Ultra Instrument à Biopsie Automatique

Automatique - Stérilisable

- *L'instrument à biopsie automatique Pro-Mag™ ULTRA est une instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de qualité.*
- *Il dispose d'une avance par "projection" de 25 mm.*
- *La gâchette est actionnée aisément de l'avant ou de l'arrière de l'instrument.*
- *Une sécurité s'active automatiquement lors de l'armement afin d'empêcher tout déclenchement accidentel.*
- *Récupération aisée de l'échantillon prélevé sans retirer l'aiguille de l'instrument.*
- *Pistolet stérilisable en autoclave et cycle prion (134°C pendant 18 minutes).*

PISTOLET PRO-MAG ULTRA		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Pistolet Pro Mag Ultra pour biopsie automatique	Unité	**PMU1000**

PISTOLET DE BIOPSIE POUR HISTOLOGIE

AIGUILLES A BIOPSIE POUR PRO-MAG™ ULTRA

Aiguilles à biopsie à usage unique pour pistolet Pro-Mag Ultra™

- *Spécialement conçues pour être utilisées avec l'instrument pour biopsie automatique Pro-Mag™ Ultra.*
- *Aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité pour des informations histologiques précises lors du diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.*
- *Une encoche d'échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique.*
- *Une embase de conception brevetée unique rend obsolètes les "espaceurs" d'aiguille.*
- *Des marques numérotées tous les centimètres facilitent un positionnement en profondeur précis.*
- *Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage.*
- *Les embases sont à code-couleur pour faciliter la détermination du calibre.*
- *Peuvent être utilisées avec des aiguilles introductrices co-axiales (vendues séparément).*
- *Conditionnées par boîte de 10 unités.*

AIGUILLES A BIOPSIE POUR PISTOLET PRO-MAG ULTRA			
Désignation		**Condt.**	**Référence**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G	2,0 mm x 10 cm	Boîte de 10	**PMUAG14G10**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G	2,0 mm x 12 cm	Boîte de 10	**PMUAG14G12**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G	2,0 mm x 16 cm	Boîte de 10	**PMUAG14G16**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G	2,0 mm x 20 cm	Boîte de 10	**PMUAG14G20**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G	1,6 mm x 10 cm	Boîte de 10	**PMUAG16G10**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G	1,6 mm x 16 cm	Boîte de 10	**PMUAG16G16**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G	1,6 mm x 20 cm	Boîte de 10	**PMUAG16G20**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G	1,2 mm x 10 cm	Boîte de 10	**PMUAG18G10**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G	1,2 mm x 16 cm	Boîte de 10	**PMUAG18G16**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G	1,2 mm x 20 cm	Boîte de 10	**PMUAG18G20**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G	1,2 mm x 25 cm	Boîte de 10	**PMUAG18G25**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G	1,2 mm x 30 cm	Boîte de 10	**PMUAG18G30**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G	0,9 mm x 10 cm	Boîte de 10	**PMUAG20G10**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G	0,9 mm x 16 cm	Boîte de 10	**PMUAG20G16**
Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G	0,9 mm x 20 cm	Boîte de 10	**PMUAG20G20**

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

HOUSSE STERILE POUR PISTOLETS DE BIOPSIE

HOUSSE STERILE POUR PISTOLETS DE BIOPSIE

Housse stérile pour la protection des pistolets de biopsie

- *Housse stérile brevetée pour une protection totale*
- *Facile à appliquer sur le pistolet de biopsie grâce au système télescopique Pull Up™*
- *Doux et transparent, sans latex*
- *Matière polyuréthane*
- *Dimensions de la protection : 9,5 x 43 cm*
- *Compatibles avec les pistolets :*
  - *BARD MAGNUM*
  - *PRO MAG*
  - *BIP*

Mode d'emploi

1. Ouvrir la housse en serrant les 2 côtés

2. Insérer le pistolet dans la housse et l'aiguille à travers l'anneau

3. Glisser l'anneau jusqu'à la base de l'aiguille

4. Déplier la housse sur le pistolet à biopsie

5. Détacher le système Pull Up™

6. Enlever la protection de l'autocollant

7. Replier la housse et fermer avec l'autocollant

HOUSSE POUR PISTOLETS DE BIOPSIE		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Housse stérile pour protection des pistolets de biopsie	Boîte de 24 unités	HOU1000

médiapi **Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com***

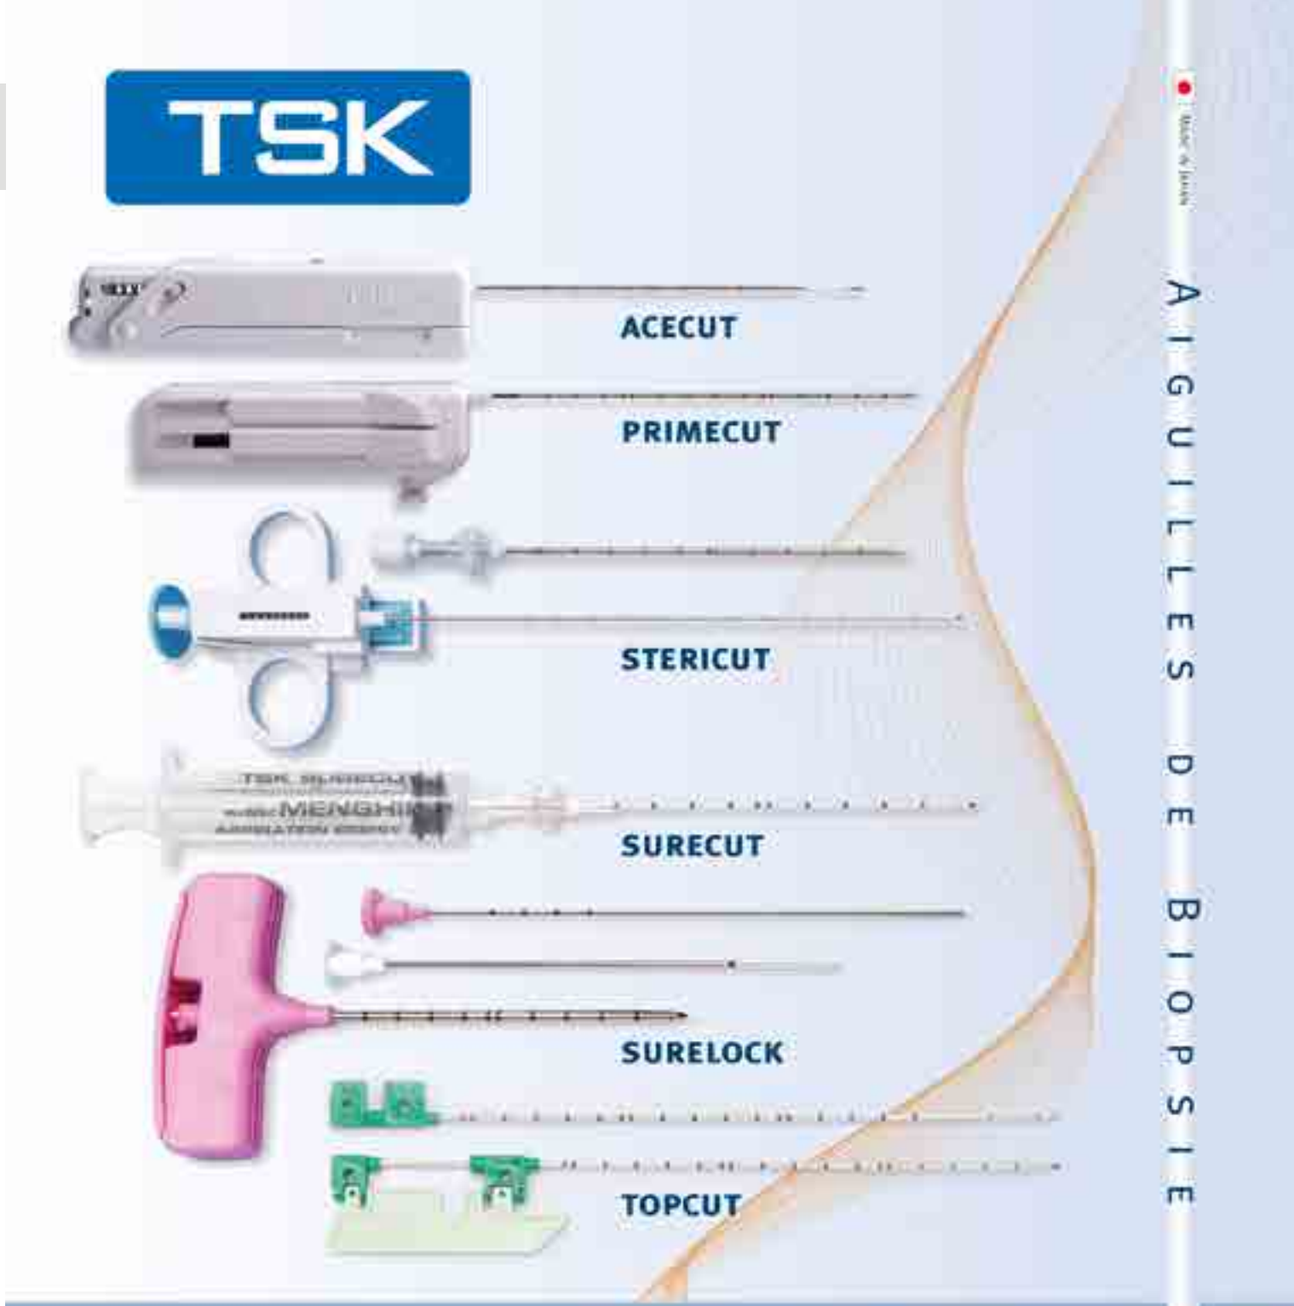

www.tsklab.com
www.mediapi.com

AIGUILLES MENGHINI POUR CYTOPONCTIONS

AIGUILLES MENGHINI SURECUT

Aiguilles pour biopsie des ganglions et prélèvements cytologiques

Compatibles avec Cameco Universel

TSK Laboratory EUROPE BV

- *SURECUT est une seringue à aspiration dédiée aux prélèvements histologiques et cytologiques de divers échantillons.*
- *Modèle équipé d'un système de piston prévu pour une utilisation précise et à une seule main.*
- *Une fois le prélèvement aspiré, un système de verrou du piston permet de retirer l'aiguille de la zone de biopsie sans risque de perte du prélèvement.*
- *La gamme SURECUT est équipée d'une aiguille échogène spécialement conçue pour un guidage avec ultrason et propose un large choix d'aiguilles de 15G à 25G avec des longueurs de 50 mm à 120 mm.*
- *D'autres longueurs sont disponibles sur demande. Longueur maxi de la gamme : 230 mm.*
- *Usage unique stérile, conditionnée en boîte de 20 unités.*

SERINGUES D'ASPIRATION SURECUT		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Seringue d'aspiration SURECUT 15G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR15G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 15G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR15G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 15G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR15G120**
Seringue d'aspiration SURECUT 16G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR16G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 16G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR16G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 16G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR16G120**
Seringue d'aspiration SURECUT 18G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR18G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 18G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR18G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 18G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR18G120**
Seringue d'aspiration SURECUT 20G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR20G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 20G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR20G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 20G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR20G120**
Seringue d'aspiration SURECUT 22G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR22G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 22G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR22G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 22G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR22G120**
Seringue d'aspiration SURECUT 25G - Long 50 mm	Boîte de 20	**SUR25G050**
Seringue d'aspiration SURECUT 25G - Long 90 mm	Boîte de 20	**SUR25G090**
Seringue d'aspiration SURECUT 25G - Long 120 mm	Boîte de 20	**SUR25G120**

PISTOLETS DE BIOPSIE POUR CYTOPONCTIONS

PISTOLETS CAMECO

Pistolets CAMECO pour cytoponctions

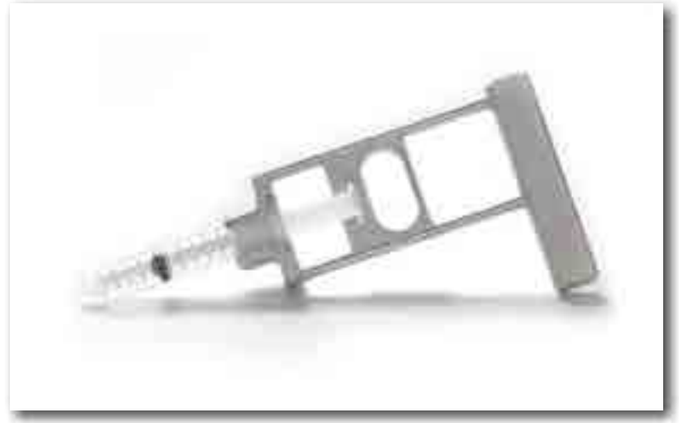

- *Pistolet pour la réalisation aisée et rapide des prélèvements cytologiques.*
- *Le pistolet permet un guidage rapide et précis de l'aiguille avec une seule main et assure un positionnement exact pour la procédure d'aspiration.*
- *Grand confort pour le patient avec un moins fort traumatisme lors du prélèvement.*
- *Le pistolet universel, grâce à sa tête pivotante, permet de recevoir des seringues jetables de 10ml et 20ml de marque BD, Once, Fabersanitas, Terumo, Monoject, Omnifix, ICO, IMS, HSW, Presida et TSK Menghini.*
- *Le pistolet est aussi disponible en version simple seringue BD 10 ml ou 20 ml.*

PISTOLETS CAMECO POUR CYTOPONCTIONS		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Pistolet à cytoponction CAMECO Universel	Unité	**CAM000**
Pistolet à cytoponction CAMECO pour seringue BD 10 ml	Unité	**CAM100**
Pistolet à cytoponction CAMECO pour seringue BD 20 ml	Unité	**CAM200**

FILS DE LOCALISATION REPOSITIONNABLES

FILS DE LOCALISATION HOMER BLN

Fils de localisation mammaire repositionnables

- *Harpon manuel repositionnable pour un marquage de haute précision dans le sein.*
- *Homer BLN utilise un harpon exclusif en "J". Son design courbe et souple permet de stabiliser et maintenir le marqueur en place.*
- *L'ancrage du harpon permet d'éviter sa migration durant la compression du sein ou encore lors du transport de la patiente.*
- *Le marquage centimétrique de l'aiguille permet de placer précisément le harpon en profondeur.*
- *Conditionné par boîte de 10 unités.*

FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE HOMER BLN		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Fil de localisation mammaire Homer BLN - 20G x 7,5 cm	Boîte de 10	**PMLHMG20G75**
Fil de localisation mammaire Homer BLN - 20G x 10 cm	Boîte de 10	**PMLHMG20G10**

FILS DE LOCALISATION NON REPOSITIONNABLES

FILS DE LOCALISATION HAWKINS™ III

Fils de localisation mammaire non repositionnables

- *Le fil de localisation mammaire non repositionnable Hawkins™ III offre une forte force d'ancrage dans le sein grâce au design de l'extrémité du fil.*
- *Fil dur traditionnel qui minimise la flexion durant la mise en place.*
- *L'embase de l'aiguille comprend une "gorge" qui permet de charger aisément le fil.*
- *Une agrafe de rétention exclusive fixée à la peau interdit la migration du fil vers l'avant durant le transport de la patiente.*
- *Le fil est marqué à deux endroits : 1 marque le fil à hauteur de l'extrémité distale de l'aiguille, 2 indique le déploiement de l'ancre.*
- *Une canule à marquage standard sur le fil, commençant à 2,5 cm de l'extrémité distale, sert de point de repère pour le chirurgien.*
- *L'extrémité comporte un trou qui sert à l'injection des contrastes et à l'aspiration des liquides.*
- *Marquage centimétrique pour faciliter le positionnement en profondeur.*
- *Avec pointe échogène.*
- *Conditionné par boîte de 10 unités.*

FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE HAWKINS™ III AVEC POINTE ECHOGENE ET FIL DUR			
Désignation	**Description**	**Condt.**	**Référence**
Fil de localisation échogène Hawkins™ III	20G x 3,0 cm, fil dur avec pointe échogène de 10,4 cm	Boîte de 10	**PMLHAW20G030**
Fil de localisation échogène Hawkins™ III	20G x 5,0 cm, fil dur avec pointe échogène de 14,4 cm	Boîte de 10	**PMLHAW20G050**
Fil de localisation échogène Hawkins™ III	20G x 7,5 cm, fil dur avec pointe échogène de 19,4 cm	Boîte de 10	**PMLHAW20G075**
Fil de localisation échogène Hawkins™ III	20G x 10,0 cm, fil dur avec pointe échogène de 24,4 cm	Boîte de 10	**PMLHAW20G100**
Fil de localisation échogène Hawkins™ III	20G x 12,5 cm, fil dur avec pointe échogène de 29,4 cm	Boîte de 10	**PMLHAW20G125**

HOUSSES STERILES POUR EQUIPEMENTS

HOUSSE STERILE POUR TABLETTES TACTILES

Housse stérile pour tablettes

- *Housse stérile à usage unique pour les tablettes tactiles afin de garantir la protection du patient, de l'utilisateur et du matériel.*
- *Simplicité d'utilisation*
- *Dimensions de la housse : 20 x 35,5 cm*

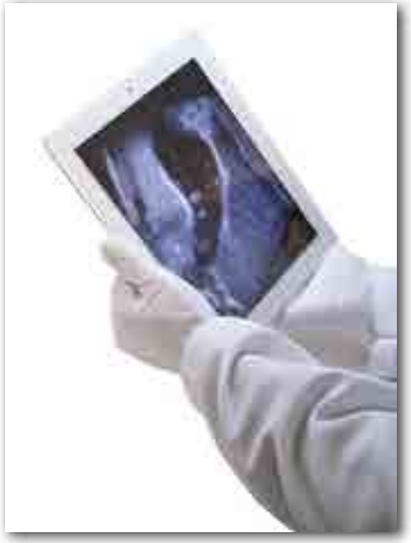

HOUSSE DE PROTECTION STERILE POUR TABLETTES TACTILES		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Housse de protection pour tablettes tactiles	Boîte de 24 unités	HOU2000

HOUSSES STERILES POUR EQUIPEMENTS

HOUSSE STERILE POUR ECHOGRAPHES

Housse stérile pour échographes

- *Système de protection stérile qui peut s'adapter sur la plupart des systèmes d'échographie*
- *Rapide et facile à utiliser*
- *La housse supérieure s'adapte sur le moniteur de l'échographe et la bande adhésive sur le rabat recouvrant le clavier garantit la fixation.*
- *Gain de temps en évitant une décontamination difficile des échographes*
- *Sans latex*
- *Dimensions : 71 x 44,5 cm*

Mode d'emploi

1. Glisser la housse de protection sur le moniteur.

2. Plier et rabattre la housse sous l'échographe.

3. Ôter la bande protectrice de la surface adhesive.

4. Fermer la housse de protection. Répéter l'opération de l'autre côté.

HOUSSE DE PROTECTION STERILE POUR ECHOGRAPHES		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Housse de protection pour échographes	Boîte de 24 unités	HOU3000

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

DESINFECTION HAUT NIVEAU - PROTOCOLE ANIOS

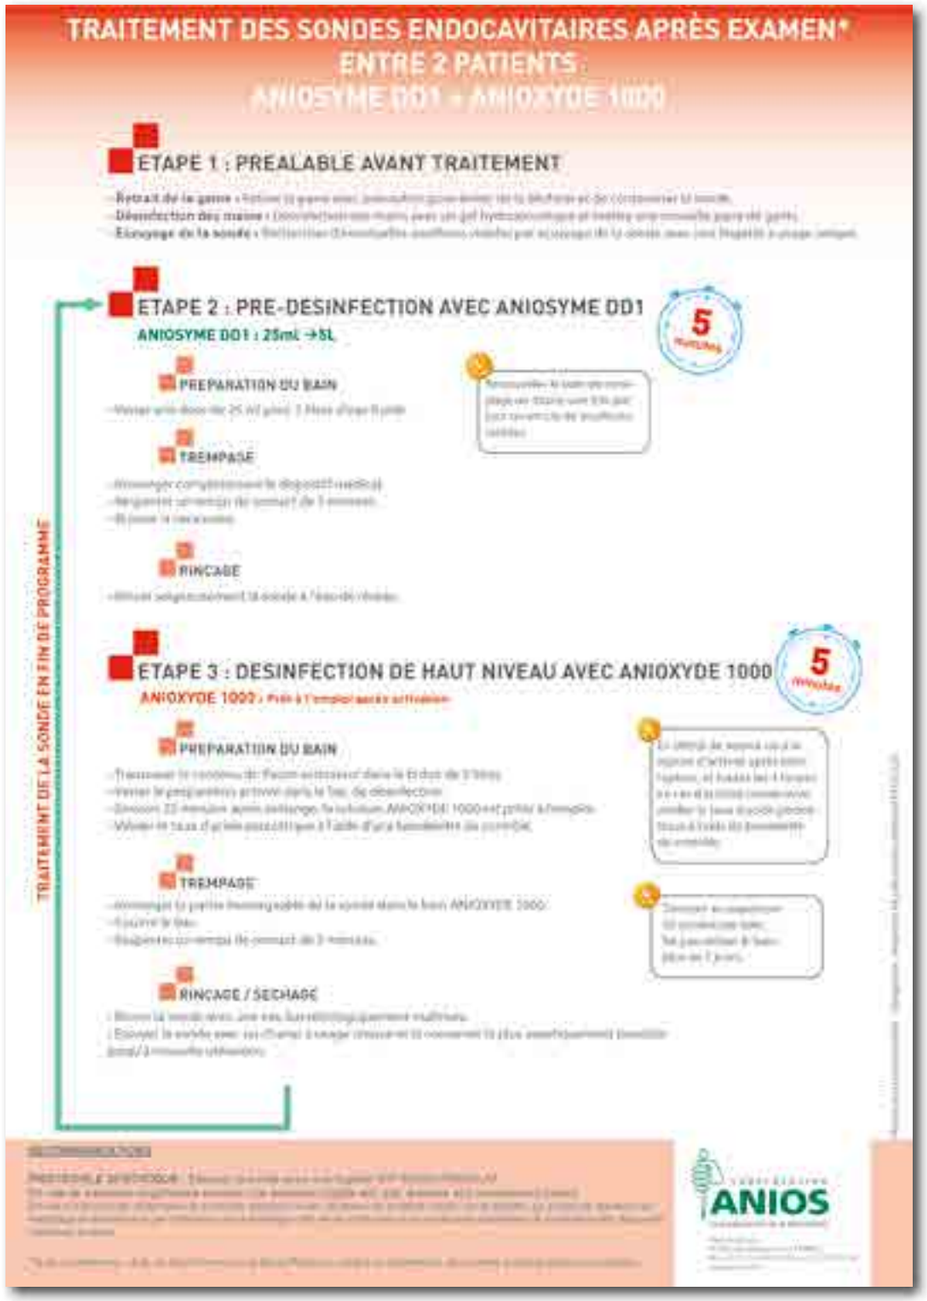

DESINFECTION HAUT NIVEAU - PROTOCOLE ANIOS

• ETAPE 1 : ESSUYAGE DE LA SONDE

LINGETTES WIP'ANIOS PREMIUM	***Lingettes humides WIP'ANIOS PREMIUM***

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Nouveau !
Sans alcool
Biodégradables

- ***Indications***

Les lingettes WIP'ANIOS PREMIUM sont imprégnées d'une solution détergente et désinfectante, pour le traitement des dispositifs médicaux entre deux patients.
La solution ne contient pas d'alcool.

- ***Propriétés microbiologiques ****

- ***Bactéries*** :
EN 1040, EN 13727, EN 13697 : 2 minutes.
MRSA selon EN 13697 : 2 minutes.

- ***Mycobactéries*** :
Mycobacterium tuberculosis (B.K.) : 5 minutes.

- ***Levures*** :
EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 5 minutes.

- ***Moisissures*** :
EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 20 minutes.

- ***Virus*** :
HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV),Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus, VRS : 1 minute.

** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi*

LINGETTES WIP'ANIOS PREMIUM			
Désignation	**Dimensions**	**Condt.**	**Référence**
Lingettes Wip'Anios Premium sans alcool	200 x 180 mm	Sachet de 100 lingettes	**LD100-PREMIUM**

DESINFECTION HAUT NIVEAU - PROTOCOLE ANIOS

• ETAPE 2 : PRE-DESINFECTION

ANIOSYME DD1

Nettoyant pré-désinfectant tri-enzymatique

• ***Indications***

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique
Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

• ***Propriétés microbiologiques ****

- ***Bactéries*** *:*
EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes), SARM (EN 13727) 5 minutes

- ***Mycobactéries*** *:*
Mycobacterium tuberculosis (B.K.) 5 minutes

- ***Levures*** *:*
EN 1275, EN 13624 15 minutes

- ***Virus*** *:*
HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1] 5 minutes, PRV (virus modèle HBV) 10 minutes

** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi*

ANIOSYME DD1		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
ANIOSYME DD1 concentré - Nettoyant tri-enzymatique	Flacon doseur 1l	**ANYME1000**
ANIOSYME DD1 concentré - Nettoyant tri-enzymatique	Dose 25 ml par 10	**ANYME200**
ANIOSYME DD1 concentré - Nettoyant tri-enzymatique	Bidon 5 l	**ANYME50**

DESINFECTION HAUT NIVEAU - PROTOCOLE ANIOS

• ETAPE 3 : DESINFECTION DE HAUT NIVEAU

ANIOXYDE 1000

Désinfection totale à froid Haut Niveau

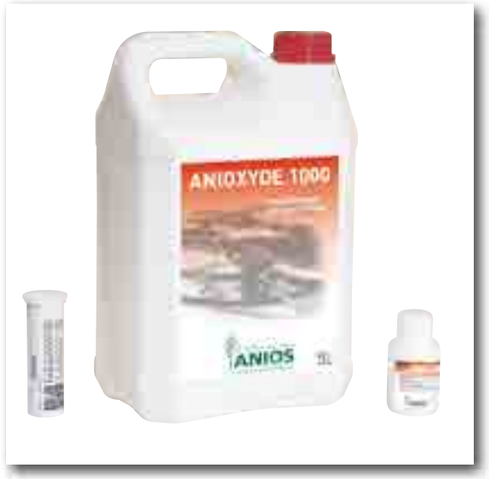

• ***Indications***

Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

• ***Propriétés microbiologiques ****

- ***Bactéries*** *:*
EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 minutes.

- ***Mycobactéries*** *:*
EN 14348, EN 14563 : 5 minutes.

- ***Levures /Moisissures*** *:*
EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 minutes.

- ***Virus*** *:*
EN 14476+A1 : 5 minutes.

- ***Spores*** *:*
EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus.
EN 13704 : Bacillus, subtilis, (5 log) Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile : 5 minutes.

** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi*

ANIOXYDE 1000		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
ANIOXYDE1000 ANIOS - Désinfection totale à froid des instruments	Bidon de 5 litres + activateur	**ADXYM50**
ANIOXYDE1000 ANIOS - Bandelettes de contrôle	Tube de 50	**ADXYBC**

DESINFECTION HAUT NIVEAU

BAC DE DECONTAMINATION POUR SONDES INVASIVES

Bac mural pour la décontamination des sondes d'échographie invasives

- *Ensemble de désinfection composé d'un réservoir destiné à recevoir tout produit de trempage pour la désinfection des sondes d'échographies.*
- *Le dispositif est équipé d'un support mural en acier époxy qui permet le séchage de deux sondes simultanément.*

Avantages :

- *Bac profond pour un parfait trempage de la sonde d'échographie.*
- *Couvercle de protection du bac pour le maintien au propre de la solution de désinfection.*
- *Platine de support mural.*
- *Ensemble facile à nettoyer.*
- *Finition lisse pour une parfaite hygiène du dispositif.*
- *Deux crochets latéraux pour le maintien des câbles et du connecteur.*
- *Dimensions extérieures : 47 x 18 x 12,5 cm.*
- *Dimensions intérieures : 42 x 14 x 8,5 cm.*
- *Jeu de trois bacs de rechange en option.*

BAC DE DECONTAMINATION POUR SONDES D'ECHOGRAPHIE	
Désignation	**Référence**
Bac mural de désinfection des sondes d'échographie endocavitaires avec couvercle	**ECHO1000**
Jeu de 3 bacs de rechange	**ECHO1090**

L'EXPERT DE LA DÉSINFECTION
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

PRODUITS **ADAPTÉS** À LA DÉSINFECTION
DES SONDES ENDOCAVITAIRES
EN TOUTE SÉCURITÉ !

ÉTAPE 1 : PRÉ-DÉSINFECTION AVEC **ANIOSYME DD1**
ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU AVEC **ANIOXYDE 1000**

- Détergence optimisée
- Efficacité antimicrobienne de haut niveau
- Large compatibilité matériel démontrée
- Formules brevetées

SPECTRE SIMPLE
ET RAPIDE
EN 2 X 5 MIN*

* Anioxyde 1000 : temps de contact 5 min.
Anioxyde 1000 : temps de contact 5 min.

laboratoires ANIOS
Parvis du Moolin
59260 Lille Hellemmes - FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 60 - Fax. +33 3 20 67 70 59
Le professionnel de la désinfection www.anios.com

DESINFECTION HAUT NIVEAU - UV-C

ANTIGERMIX® S1

Enceinte de désinfection des sondes d'échographie externes et endocavitaires haut niveau par UV-C Antigermix®

Désinfection haut niveau des sondes d'échographie

- *Simple : Un seul branchement électrique*
- *Rapide : Désinfection de haut niveau en moins de 3 min sans débrancher la sonde*
- *Fiable : Vérification automatique du niveau de désinfection*
- *Traçabilité : Automatisée*
- *Ecologique : Sans produit chimique*

- *Véritable alternative au trempage chimique, il assure une désinfection de la sonde entre deux patients sans la déconnecter de l'échographe.*

- *Fabriqué en France. Brevets français (National et International).*

- *L'Antigermix® S1 a fait l'objet d'une évaluation positive de l'Ansm et du StatensSerum Institut (Danemark).*

- *Rapidité du cycle de désinfection*

Cycle I en 90s : désinfection de niveau haut
Cycle II en 200s : désinfection de niveau haut + aspergillus niger

- *Fiabilité*

Garantie de désinfection : chaque désinfection est automatiquement validée par la mesure précise de la dose d'UV-C reçue par la sonde. A la fin du cycle, le système signale le statut de la désinfection réalisée sur le panneau de contrôle et les différents supports de traçabilité.

- *Simplicité*

Désinfection de la sonde en un seul clic sans la déconnecter de l'échographe. Aucune configuration spécifique requise (un simple raccordement électrique suffit). Prise en main immédiate du système par les utilisateurs.

- *Traçabilité*

Impression sur étiquette des données pertinentes (établissement, ID patient, ID appareil, horodatage, ID sonde (RFID), statut de la désinfection,…).
Logiciel GERMITRAC® de traçabilité et stockage illimité de l'ensemble des données relatives à l'ensemble des cycles de désinfection de la sonde. Une application place l'étiquette électronique de traçabilité dans le compte-rendu du patient ayant bénéficié de la désinfection et parfait ainsi le système qualité de l'établissement.

- *Sécurité et Environnement*

Le traitement UV-C est non corrosif pour les sondes d'échographie, non toxique pour le praticien ou le patient.
Le traitement UV-C préserve l'environnement (aucun risque toxique, ni effluent engendré).

- *Certifications et Agréments*

Germitec est certifiée ISO 9001 & ISO 13485
Antigermix® S1 est un dispositif médical de classe IIb et porte le marquage CE0459

DESINFECTION HAUT NIVEAU - UV-C

ANTIGERMIX® S1

Enceinte de désinfection des sondes d'échographie externes et endocavitaires haut niveau par UV-C Antigermix®

Spécifications techniques

Durée moyenne de la désinfection : *(selon la mesure de dose effective)*	***• CYCLE I : 90s*** ***• CYCLE II : 200s***
Selon directive 93/42/CEE	*Dispositif médical de Classe IIb*
Dimensions *Enceinte cylindrique*	*Diamètre : 55 cm* *Hauteur : 100 cm*
Poids :	*50 kg*
Conditions électriques	
Alimentation :	*230 volts VAC*
Puissance :	*510 Watt*
Intensité :	*3,3 A*
Fréquence :	*50/60 Hz*
Conditions de fonctionnement	
Température :	*+15°C - + 45 °C*
Humidité maximum :	*75%*
Validations	
Certification	*CE 0459*
CEM	*EN 61326 versions A 4 2006*
Sécurité électrique	*EN 61010 2 40 versions 2005*
Pouvoir désinfectant	*D'après EN 14651, EN 14562, EN 14563, EN 14476*
Etudes cliniques	*Performances Ex vivo HEGP, Hôpital Necker, IRP*

Logiciel GERMITRAC ®
- *Traçabilité*
- *Stockage des données relatives à l'ensemble des cycles de désinfection de la sonde*
- *Consultation en intranet*
- *Extraction et impression des données*

ANTIGERMIX S1 POUR DESINFECTION DES SONDES D'ECHOGRAPHIE	
Désignation	**Référence**
Enceinte Antigermix® S1	**GERM1000**

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • Tous nos produits sur www.mediapi.com

STERILISATION

AUTOCLAVES C3 ADVANCE TYPE B

Autoclaves de classe B avec cycle Prion

Points forts :

- *Design innovant avec un choix de 4 couleurs différentes afin de coordonner l'autoclave avec votre cabinet*
- *Verrouillage de la porte automatique. Aucun effort à fournir.*
- *Livré de série avec 6 plateaux. Plateau support sachet pellable disponible en option.*
- *Compact et autonome, vous n'avez qu'à brancher la prise sur le secteur pour le faire fonctionner. (Pas de plomberie à prévoir)*
- *Cycles avec vide accélérés qui permettent un gain de temps et une meilleure rotation des instruments*
- *Modèle 16 litres ou 22 litres avec une contenance totale de 6 plateaux*
- *Traçabilité avec la sauvegarde des cycle via l'imprimante ou sur carte mémoire 25000 cycles*
- *Cycles pré-réglés : 2 cycles en classe B, 1 cycle en classe TP, 1 cycle en classe N+ et 2 cycles en classe N.*
- *Garantie 2 ans pièces avec main d'oeuvre sur site durant la première année.*
- *Cuve garantie 10 ans.*
- *Corps chauffant garanti à vie.*

STERILISATION

AUTOCLAVES C3 ADVANCE TYPE B

Autoclaves de classe B avec cycle Prion

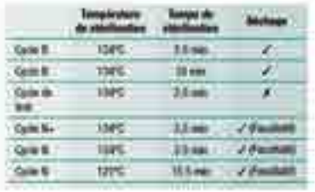

Fonctionne de manière autonome
Installation requise : 1 prise secteur 220 V !

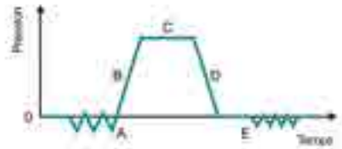

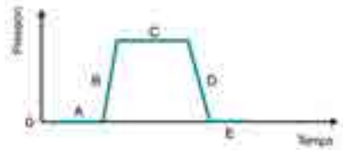

AUTOCLAVES C3 ADVANCE TYPE B	
Désignation	**Référence**
Stérilisateur Autoclave C3 Advance 16 litres type B	**AC316**
Stérilisateur Autoclave C3 Advance 22 litres type B	**AC322**
Imprimante externe pour autoclave C3 Advance	**AC3900**
Plateau grille supplémentaire pour autoclave AC316	**AC3901**
Plateau grille supplémentaire pour autoclave AC322	**AC3902**
Test de Bowie Dick	**AC3903**
Solution nettoyante pour autoclave C3 Advance	**AC3904**
Filtre à air pour autoclave C3 Advance	**AC3905**
Imprimante externe pour autoclave C3 Advance	**AC3906**

NOTES

ANTIGERMIX®

Rapidité
Désinfection de Niveau Haut (DNH) en moins de 3 mn

Traçabilité
Impression sur étiquette
Insertion de l'étiquette numérique dans le compte-rendu

Logiciel GERMITRAC
Stockage des données relatives
à l'ensemble des cycles de désinfection de la sonde

Simplicité
Désinfection de la sonde en un seul clic

Economique
Aucune perte d'activité liée au temps de désinfection
Aucun consommable

Ecologique
Zéro résidu, zéro rejet, zéro déchet

GERMITEC

HYGIENE ET DESINFECTION

SURFA'SAFE ANIOS

Désinfection des surfaces, notamment des divans d'échographie

- ***Indications :***

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.

- ***Propriétés microbiologiques ****

- ***Bactéries*** *:*
EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697 : 2 minutes.
Selon EN 13697 : Acinetobacter baumannii BLSE, Enterobacter cloacae BLSE,Enterobacter aerogenes BLSE, Escherichia coli BLSE, Enterococcus ERV, Klebsiella pneumoniae BLSE, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Serratia marcescens, Staphylococcus SARM : 2 minutes.

- ***Mycobactéries*** *:*
Mycobacterium tuberculosis (B.K): 15 minutes.

- ***Levures*** *:*
EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 5 minutes.

- ***Moisissures*** *:*
EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 20 minutes.
Aspergillus fumigatus (EN 14562) : 15 minutes.
Tricophyton mentagrophytes (EN 13697) : 15 minutes.

- ***Virus :***
Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (HBV), BVDV (HCV), Vacciniavirus*, Herpès virus, VRS, Rotavirus : 1 minute.*
Influenzavirus A [H 1N1] (EN 14476) : 2 minutes.
Feline Calicivirus (Norovirus) : 15 minutes.

** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

SURFA'SAFE ANIOS		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
ANIOS SURFA'SAFE - Mousse compacte	Capot blanc - Flacon diffuseur 750 ml	**ASSAFE750**
ANIOS SURFA'SAFE - Spray compact	Capot rouge - Flacon spray 750 ml	**ASSAFE751**

HYGIENE DES MAINS

Toute la gamme des produits ANIOS sur www.mediapi.com

SAVON DOUX ANIOS HAUTE FREQUENCE

Savon doux Anios Haute Fréquence pour le lavage des mains

- ***Indications***

Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

- ***Propriétés microbiologiques***

Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

SAVON DOUX HAUTE FREQUENCE ANIOS		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	Flacon 500 ml + pompe vissée	**AHMHF12-500**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	6 flacons 500 ml + 2 pompes 2cc	**AHMHF6-500**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	Flacon Airless 1 l	**AHMHF12-1000A**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	Flacon 1 l + pompe 2cc vissée	**AHMHF1000**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	3 flacons 1 l + 2 pompes doseuses 2cc	**AHMHF3-1000**
SAVON DOUX ANIOS HF - pH neutre	Bidon 5 l	**AHMHF1-5000**

HYGIENE DES MAINS

ANIOSGEL 85 NPC ANIOS

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains

La référence !

- *Formule hypoallergénique*
- *Large spectre anti-microbien*
- *Pratique à utiliser*
- *Sans parfum ni colorant*

- ***Indications***

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- ***Propriétés microbiologiques***

- Bactéries :
*EN 1040, EN 1276**
Selon EN 13727 (07/2012) : BMR*
Selon EN 13727 : Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis*

- Mycobactéries : *EN 14348* : 30 secondes*

- Levures/Moisissures :
EN 1275, EN 13624, EN 1650* ;*
Tricophyton mentagrophytes (EN 1650) : 30 secondes*

- Virus : *EN 14476* (Poliovirus, Adenovirus) ;*
Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (HBV),BVDV (HCV), Rotavirus, Norovirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A, virus H5N1 et H1N1 Coronavirus (SRAS) : 30 secondes*

- Friction Hygiénique *:*
EN 13727, EN 1500 (2013) - 1 creux de main (3ml minimum) pour un temps de friction de 30 secondes
- Friction Chirurgicale *:*
EN 13727, EN 12791 : 2 x 1 creux de main (2 x 3 ml minimum) pour un temps de friction de 2 x45 secondes

** Tests réalisés en conditions de propreté selon le référentiel Européen de Normalisation*

ANIOSGEL 85 NPC ANIOS		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
ANIOSGEL 85 NPC - Hygiène et désinfection des mains	20 flacons de 75 ml	**AG85NPC75**
ANIOSGEL 85 NPC - Hygiène et désinfection des mains	Flacon de 300 ml + pompe vissée	**AG85NPC300**
ANIOSGEL 85 NPC - Hygiène et désinfection des mains	Flacon de 500 ml + pompe 2cc	**AG85NPC500**
ANIOSGEL 85 NPC - Hygiène et désinfection des mains	Flacon Airless de 1l	**AG85NPC1000A**
ANIOSGEL 85 NPC - Hygiène et désinfection des mains	Flacon de 1l + pompe 2 cc	**AG85NPC1000**

OUATE ET PROTECTION

Gamme complète de ouate et champs de protection
Contactez-nous ! Tél : +33 (0)2 48 50 88 77

DRAPS D'EXAMEN BLANCS MICRO-GAUFRES

Draps d'examen pour divans d'échographie

Excellent rapport qualité- prix !

- *Très haute qualité*
- *Prédécoupe aisée*
- *Pure ouate (2 x 18g)*
- *100% pure cellulose doux et résistant*
- *138 formats de 50 x 38 cm*
- *Longueur : 52 m*

DRAPS D'EXAMEN BLANCS MICRO-GAUFRES		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Draps d'examen micro-gaufrés	Carton de 9 rouleaux	**DRB50X38MGHD**

DRAPS D'EXAMEN BLANCS LISSES

Draps d'examen pour divans d'échographie

- *Très haute qualité*
- *Prédécoupe aisée*
- *Ouate de cellulose (2 x 18g)*
- *Rouleaux de 150 formats prédécoupés 50 x 38 cm*

DRAPS D'EXAMEN BLANCS LISSES		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Draps d'examen blancs lisses	Carton de 12 rouleaux	**DRB50X38LI**

PORTE ROULEAU DRAPS D'EXAMEN

Porte rouleau drap d'examen en acier chromé

- *Pour fixation sur le divan d'examen*
- *En acier chromé*

PORTE ROULEAU	
Désignation	**Référence**
Porte rouleau draps d'examen	**DRPORTEROULEAU**

OUATE ET PROTECTION

ESSUIE MAINS EN ROULEAU

Essuie mains en rouleaux STAR MINI

- *Essuie mains en rouleau à dévidage central*
- *100% pure ouate de cellulose lisse, 3 plis*
- *Rouleau de 191 feuilles, 350 x 215 mm*
- *Dimensions du rouleau : 67 m, diamètre 12,5 cm*

ESSUIE MAINS EN ROULEAU STAR MINI		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Essuie mains rouleaux STAR MINI	Colis de 12 rouleaux	**ESM02**

ESSUIE MAINS DEVIDAGE CENTRAL

Essuie mains à dévidage central

- *Essuie mains à dévidage central*
- *100 % pure ouate de cellulose, 2 plis micro-gaufrés*
- *Rouleau de 157 formats, 38 x 21,4 cm*
- *Dimensions du rouleau : 60 m, diamètre 13 cm*
- *Diamètre du mandrin : 5,10 cm*

ESSUIE MAINS DEVIDAGE CENTRAL		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Essuie mains Dévidage central	Colis de 6 rouleaux	**ESM04**

OUATE ET PROTECTION

ESSUIE MAINS FEUILLE A FEUILLE

Essuie mains feuille à feuille Z TOP ou I LUX

Modèle Z Top

- *Essuie mains feuille à feuille*
- *Papier recyclé ouaté aspect micro-gaufré*
- *Carton de 20 paquets de 143 feuilles*
- *Format de chaque feuille : 234 x 230 mm*
- *2 plis Wave*

- *Essuie mains feuille à feuille I LUX*
- *100% pure ouate de cellulose 2 plis micro-gaufrés*
- *Carton de 20 paquets de 160 feuilles*
- *Format de chaque feuille : 220 x 320 mm*

Modèle I LUX

ESSUIE MAINS FEUILLE A FEUILLE		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Essuie mains feuille à feuille Z Top	Carton de 20 paquets de 143 feuilles	**ESM01**
Essuie mains feuille à feuille I lux	Carton de 20 paquets de 160 feuilles	**ESM00**

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • *Tous nos produits sur www.mediapi.com*

OUATE ET PROTECTION

ESSUIE MAINS DEVIDAGE CENTRAL

Essuie mains à dévidage central

- *100 % pure cellulose*
- *2 plis micro-gaufrés*
- *Rouleau de 450 formats, 30,50 x 19,7 cm*
- *Dimension du rouleau : 137 m, diamètre 19,30 cm*
- *Diamètre du mandrin : 6 cm*

ESSUIE MAINS DEVIDAGE CENTRAL		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Essuie mains Dévidage central	Colis de 6 rouleaux	**ET04**

ESSUIE TOUT UNICO MICRO-GAUFRES

Essuie-tout en rouleau pour nettoyage du gel d'échographie

- *Essuie tout Unico*
- *Sans dévidage central, avec pré-découpe*
- *Pure ouate de cellulose*
- *2 plis micro-gaufrés*
- *Rouleau de 309 formats, 225 x 235 mm*
- *Dimensions du rouleau : 69,5 m, diamètre 16,80 cm*

ESSUIE TOUT UNICO MICRO-GAUFRES		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Essuie tout UNICO Micro gaufrés	Colis de 6 rouleaux	**ET02**

OUATE ET PROTECTION

Nombreux autres modèles de gants disponibles
Contactez-nous ! Tél : +33 (0)2 48 50 88 77

GANTS D'EXAMEN LATEX PRE POUDRES

Gants d'examen latex pré-poudrés

- *Standard incontournable des gants en latex*
- *Surface lisse pour une excellente préhension alliée à un excellent toucher*
- *Ambidextre*
- *Conforme aux normes européennes : marquage CE*
- *Longueur : 240 mm*

GANTS D'EXAMEN LATEX PRÉ-POUDRÉS		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gants latex 240 mm pré-poudrés taille 5/6 (XS)	Boîte de 100 gants	**PGLP5/6**
Gants latex 240 mm pré-poudrés taille 6/7 (S)	Boîte de 100 gants	**PGLP6/7**
Gants latex 240 mm pré-poudrés taille 7/8 (M)	Boîte de 100 gants	**PGLP7/8**
Gants latex 240 mm pré-poudrés taille 8/9 (L)	Boîte de 100 gants	**PGLP8/9**
Gants latex 240 mm pré-poudrés taille 9/10 (XL)	Boîte de 100 gants	**PGLPXL**

GANTS D'EXAMEN VINYLE NON POUDRES

Gants d'examen vinyle non poudrés

- *Gants hypoallergéniques et ambidextres*
- *Idéal pour une excellente protection*
- *Non poudrés*
- *Longueur : 240 mm*
- *Ne contient pas de latex*
- *Marquage CE*

GANTS D'EXAMEN VINYLE NON POUDRES		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gants vinyle 240 mm non poudrés taille 5/6 (XS)	Boîte de 100 gants	**PGVNP5/6**
Gants vinyle 240 mm non poudrés taille 6/7 (S)	Boîte de 100 gants	**PGVNP6/7**
Gants vinyle 240 mm non poudrés taille 7/8 (M)	Boîte de 100 gants	**PGVNP7/8**
Gants vinyle 240 mm non poudrés taille 8/9 (L)	Boîte de 100 gants	**PGVNP8/9**
Gants vinyle 240 mm non poudrés taille 9/10 (XL)	Boîte de 100 gants	**PGVNPXL**

GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRES

Gants d'examen nitrile non poudrés

- *Recommandés pour les personnes ne pouvant utiliser de gants en latex*
- *Résistance à de nombreux produits chimiques et à la perforation, en comparaison au latex naturel*
- *Produit en matière synthétique anallergique, performant en milieu pharmaceutique, en salle blanche*
- *Ambidextres, extrémités distales rugueuses. L: 240 mm. Coloris : bleu*
- *Marquage CE*

GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRES		
Désignation	**Conditionnement**	**Référence**
Gants nitrile bleu 240 mm non poudrés taille 6/7 (S)	Boîte de 100 gants	**PGNNP6/7**
Gants nitrile bleu 240 mm non poudrés taille 7/8 (M)	Boîte de 100 gants	**PGNNP7/8**
Gants nitrile bleu 240 mm non poudrés taille 8/9 (L)	Boîte de 100 gants	**PGNNP8/9**
Gants nitrile bleu 240 mm non poudrés taille 9/10 (XL)	Boîte de 100 gants	**PGNNPXL**

MOBILIER MEDICAL

DIVAN D'EXAMEN ECO A HAUTEUR FIXE

Divan hauteur fixe pour examens échographiques

• Table d'examen à hauteur fixe de 500 mm ou 600 mm

- *Longueur de plan : 2000 mm*
- *Sellerie épaisseur 40 mm*
- *Largeur : 800 mm*
- *Dossier réglable par autoblocage mécanique*
- *Coloris sellerie gris nuage*
- *Bâti époxy gris clair*
- *Sellerie M1 épaisseur 40 mm*
- *Livré avec porte rouleau*
- *Poids supporté : 200 kg*
- *Livré avec pieds démontés*
- *Roulettes diamètre 100 mm en option*

Options roulettes

DIVAN MODELE ECO POUR EXAMENS ECHOGRAPHIQUES		
Désignation	**Dimensions**	**Référence**
Divan d'examen Eco Hauteur fixe 600 mm avec porte rouleau	H 600 x l 800 x L 2000 mm	**DIVECO600**
Divan d'examen Eco Hauteur fixe 500 mm avec porte rouleau	H 500 x l 800 x L 2000 mm	**DIVECO500**
Jeu de 4 roulettes à freins	Diamètre 100 mm	**DIVECO900**

MOBILIER MEDICAL

DIVAN D'EXAMEN CAIX A HAUTEUR VARIABLE

Table élévatrice biplan à hauteur variable électrique

• Table élévatrice électrique biplan à hauteur variable de 560 à 960 mm par commande au pied

- *Longueur de plan : 2000 mm*
- *Sellerie cousue, épaisseur 40mm*
- *Disponible en largeur 670 ou 800 mm*
- *Déplacement vertical de 400 mm*
- *Dossier réglable par vérin à gaz*
- *Bâti epoxy blanc*
- *Porte rouleau intégré sous le plan côté pied*
- *Sellerie au choix M1 ou M2*
- *Poids supporté : 220 kg*
- *Roulettes diamètre 100 mm en option*

Position haute

Longueur du plan : 2000 mm

DIVAN MODELE CAIX POUR EXAMENS ECHOGRAPHIQUES		
Désignation	**Dimensions**	**Référence**
Divan CAIX à hauteur variable électrique	L 2000 x H 560/960 x l. 670 mm	**DIVCAI670**
Divan CAIX à hauteur variable électrique	L 2000 x H 560/960 x l. 800 mm	**DIVCAI800**
Option roulettes escamotables	Diamètre 100 mm à frein	**DIVCAI900**
Option paire de barrières latérales rabattables		**DIVCAI901**

MOBILIER MEDICAL

DIVAN D'EXAMEN QUEST POUR ECHOGRAPHIE

Divan haute qualité à hauteur variable électrique pour la réalisation des examens d'échographie

- ***Confort***
- ***Hygiène***
- ***Sécurité***
- ***Accessibilité***

Modèle présenté avec options

Système Block'n Roll

- *Divan d'examen à hauteur variable électrique de 460 mm à 920 mm*

- *Pied en H très stable*
- *Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique*
- *Proclive- Déclive (sur certains modèles)*
- *Système Block'n Roll® exclusif*
- *Largeur utile 100% de la sellerie*
- *Mouvements électriques doux*
- *Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)*
- *Structure acier avec finition époxy gris nuage*
- *Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm, diam12,5 cm)*
- *Sellerie non feu M1*
- *Bras d'élévation robustes*
- *Commande manuelle en standard*
- *Compatible avec un lève-malade*
- *Nombreuses options et accessoires pour personnaliser votre divan*
- *Poids supporté : 200 kg*

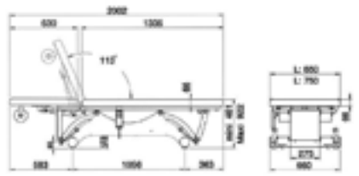

Accueil

Examen général

Déclive

Proclive

Position haute

DIVAN MODELE QUEST POUR EXAMENS ECHOGRAPHIQUES		
Désignation	**Caractéristiques**	**Référence**
Divan Quest Hauteur variable Electrique 460 à 920 mm	Block'n Roll / Sans sellerie	**DIVQUE100**
Divan Quest Hauteur variable Electrique 460 à 920 mm	Proclive/ Déclive/ Dossier gaz/ Block'n Roll / Sans sellerie	**DIVQUE200**
Divan Quest Hauteur variable Electrique 460 à 920 mm	Proclive/ Déclive/ Dossier Electrique/ Block'n Roll / Sans sellerie	**DIVQUE300**
Divan Quest Hauteur variable Electrique 460 à 920 mm	Patins/ Sans sellerie	**DIVQUE400**
Divan Quest Hauteur variable Electrique 460 à 920 mm	Proclive/ Déclive/ Dossier gaz/ Patins / Sans sellerie	**DIVQUE500**
Sellerie plate	Largeur 65 cm	**DIVQUE900**
Sellerie plate	Largeur 75 cm	**DIVQUE901**
Sellerie à bourrelets	Largeur 65 cm	**DIVQUE902**
Sellerie à bourrelets	Largeur 75 cm	**DIVQUE903**
Sellerie anatomique luxe	Largeur 73 cm	**DIVQUE904**
Appui-bras unitaire pour divans et fauteuils de prélèvement		**DIVQUE905**
Paire d'étaux porte accessoires		**DIVQUE906**
Paire d'étriers gynécologiques	Inox	**DIVQUE907**

REPROGRAPHES ET PAPIERS

• *REPROGRAPHES ANALOGIQUES*

IMPRIMANTE SONY UP-897MD

Imprimante analogique Noir et Blanc format A6

- *Imprimante noir et blanc préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, C-ARM, Echo-endoscopie*
- ***Format A6 monochrome***
- ***Points forts :***

- Conçue spécifiquement pour être utilisée avec les équipements de diagnostic médical tels que les échographes
- Design compact et léger
- Qualité d'impression des images avec une haute résolution de 325 dpi et un excellent niveau de gris

- ***Interface :*** *Entrée analogique video composite YC*
- ***Papiers compatibles :*** *UPP110HD/ UPP110HG/ UPP110S*

IMPRIMANTE SONY UP-25MD

Imprimante analogique Couleur format A6

- *Imprimante couleur préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, Endoscopie, Micro chirurgie, Microscope, Analyses*
- ***Format A6 couleur***
- ***Points forts :***

- Design compact et léger
- Polyvalente, peut être utilisée dans de nombreuses applications médicales

- ***Interface :*** *Entrée analogique video composite YC, SVideo, RGB*
- ***Papiers compatibles :*** *UPC21L, UPC21S, UPC24LA, UPC24SA*

IMPRIMANTE SONY UP-55MD

Imprimante analogique Couleur format A5

- *Imprimante couleur préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, Endoscopie, Micro chirurgie, Microscope, Analyses*
- ***Format A5 couleur***
- ***Points forts :***

- Design ultra compact
- Conçue pour un usage intensif fiable et durable

- ***Interface :*** *Entrée analogique SYVidéo, Vidéo, SVidéo, RGB*
- ***Papiers compatibles :*** *UPC-55*

IMPRIMANTE SONY UP-970AD

Imprimante numérique et analogique Noir et Blanc format A4

- *Imprimante noir et blanc préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, C-ARM*
- ***Format A4 monochrome***
- ***Points forts :***

- Haute qualité et précision des niveaux de gris
- Vitesse d'impression de 8 s
- Mode d'impression multiples

- ***Interface*** *: Entrée numérique USB 2.0 et analogique vidéo composite YC*
- ***Papiers compatibles :*** *UPP210HD/ UPP210SE*

REPROGRAPHES ET PAPIERS

• REPROGRAPHES NUMERIQUES

IMPRIMANTE SONY UP-D711MD

Imprimante numérique Noir et Blanc format A7

- *Imprimante noir et blanc la plus petite du marché, solution idéale pour l'échographie*
- ***Format A7 monochrome***
- ***Points forts :***

- Extremement compacte : seulement 12,5 cm de profondeur
- Très légère : seulement 1kg
- Faible consommation d'énergie

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papiers compatibles :** UPP84S/ UPP84HG*

IMPRIMANTE SONY UP-D897

Imprimante numérique Noir et Blanc format A6

- *Imprimante noir et blanc préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, C-Arm, Echo-endoscopie, Dentaire*
- ***Format A6 monochrome***
- ***Points forts :***

- Désign compact et léger
- Mode d'impressions multiples

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papiers compatibles :** UPP110HD, UPP110HG, UPP110S*

IMPRIMANTE SONY UP-D25MD

Imprimante numérique Couleur format A6

- *Imprimante couleur préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, Endoscopie, Microchirurgie, Microscope, Analyse, Ophtalmoglogie*
- ***Format A6 couleur***
- ***Points forts :***

- Désign compact et léger
- Impression qualité photo avec la sublimation Sony

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papiers compatibles :** UPC21L, UPC21S, UPC24LA, UPC24SA*

IMPRIMANTE SONY UP-D55

Imprimante numérique couleur format A5

- *Imprimante couleur préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, Endoscopie, Microchirurgie, Microscope, Analyse, Ophtalmoglogie*
- ***Format A5 couleur***
- ***Points forts :***

- Désign compact
- Polyvalence

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papiers compatibles :** UPC55*

REPROGRAPHES ET PAPIERS

• REPROGRAPHES NUMERIQUES

IMPRIMANTE SONY UP-970AD

Imprimante numérique et analogique Noir et Blanc format A4

- *Imprimante noir et blanc préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, C-ARM*
- ***Format A4 monochrome***
- ***Points forts :***

- Haute qualité et précision des niveaux de gris
- Vitesse d'impression de 8 s
- Mode d'impressions multiples

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0 et analogique vidéo composite YC*
- ***Papiers compatibles :** UPP210HD/ UPP210SE*

IMPRIMANTE SONY UP-DR80MD

Imprimante numérique Couleur format A4

- *Imprimante couleur préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, Endoscopie, Microchirurgie, Microscope, Analyse, Ophtalmologie*
- ***Format A4 couleur***
- ***Points forts :***

- Haute résolution, qualité photo
- Design compact

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papier compatible :** UPCR80MD*

IMPRIMANTE SONY UP-D72XR

Imprimante numérique Noir et Blanc format 20 x 25 cm

- *Imprimante noir et blanc préconisée pour les modalités suivantes : Echographie, C-Arm, Dentaire, Vétérinaire*
- ***Format 20 x 25 cm monochrome***
- ***Points forts :***

- Format médical 20 x 25 cm
- Compatible papier thermique et film

- ***Interface** : Entrée numérique USB 2.0*
- ***Papier compatible :** UPP725*
- ***Film compatible :** UPT735BL*

IMPRIMANTES SONY			
Désignation	**Caractéristiques**	**Format d'entrée**	**Référence**
Imprimante SONY UP-897MD	Analogique - A6 - Monochrome	Entrée analogique vidéo composite YC	**UP897MD**
Imprimante SONY UP-25MD	Analogique - A6 - Couleur	Entrées analogiques video composite YC, SVidéo, RGB	**UP25MD**
Imprimante SONY UP-55MD	Analogique - A5 - Couleur	Entrées analogiques SYVidéo, Vidéo, SVidéo, RGB	**UP55MD**
Imprimante SONY UP-970AD	Analogique et numérique - A4 - Monochrome	Entrée numérique USB 2.0 et analogique vidéo composite YC	**UP970AD**
Imprimante SONY UP-D711MD	Numérique - A7 - Monochrome	Entrée numérique USB 2.0	**UPD711MD**
Imprimante SONY UP-D897	Numérique - A6 - Monochrome	Entrée numérique USB 2.0	**UPD897**
Imprimante SONY UP-D25MD	Numérique - A6 - Couleur	Entrée numérique USB 2.0	**UPD25MD**
Imprimante SONY UP-D55	Numérique - A5 - Couleur	Entrée numérique USB 2.0	**UPD55**
Imprimante SONY UP-DR80MD	Numérique - A4 - Couleur	Entrée numérique USB 2.0	**UPDR80MD**
Imprimante SONY UP-D72XR	Numérique - 20 x 25 cm - Monochrome	Entrée numérique USB 2.0	**UPD72XR**

médiapi Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77 - Fax : +33 (0)2 48 50 88 79 • Tous nos produits sur www.mediapi.com

REPROGRAPHES ET PAPIERS

PAPIER THERMIQUE SONY UPP110HA

Rouleau de papier thermique Sony UPP110HA

- *Rouleau de papier thermique Sony format A6 noir et blanc*
- *Qualité standard*
- *Longueur : 18 m*
- *Largeur : 110 mm*

PAPIER THERMIQUE UPP110HA		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Rouleau thermique SONY UPP110HA	Unité	**RTS110HA**

PAPIER THERMIQUE SONY UPP110HD

Rouleau de papier thermique Sony UPP110HD

- *Rouleau de papier thermique Sony format A6 noir et blanc*
- *Qualité Haute Densité*
- *Longueur : 20 m*
- *Largeur : 110 mm*

PAPIER THERMIQUE UPP110HD		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Rouleau thermique SONY UPP110HD	Unité	**RTS110HD**

PAPIER THERMIQUE SONY UPP110HG

Rouleau de papier thermique Sony UPP110HG

- *Rouleau de papier thermique Sony format A6 noir et blanc*
- *Qualité Photo Glacé Brillant*
- *Longueur : 18 m*
- *Largeur : 110 mm*

PAPIER THERMIQUE UPP110HG		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Rouleau thermique SONY UPP110HG	Unité	**RTS110HG**

PAPIER THERMIQUE SONY UPP110S

Rouleau de papier thermique Sony UPP110S

- *Rouleau de papier thermique Sony format A6 noir et blanc*
- *Qualité Strong (mince)*
- *Longueur : 20 m*
- *Largeur : 110 mm*

PAPIER THERMIQUE UPP110S		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Rouleau thermique SONY UPP110S	Unité	**RTS110S**

REPROGRAPHES ET PAPIERS

PAPIERS COLOR COPY

Papiers Color Copy Laser Haute Densité

La gamme la plus complète en matière de formats et grammages. Son lissé supérieur et sa blancheur idéale garantissent un rendu des couleurs brillant, fidèle à l'original et des résultats d'impression parfaits.

- ***Aptitudes :***

Reprographie spécial laser couleur haut débit

- ***Garanties :***

Photocopieurs noir et couleur
Imprimantes laser : noir et couleur
Pré-impression offset
Certification FSC

- ***Spécifications :***

Offset pigmenté reprographique
Pâte ECF
Papier permanent garanti pour l'archivage (Iso 9706)

PAPIERS COLOR COPY LASER HAUTE DENSITE		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Papier Color Copy Laser Haute Densité A4 - 120g	Ramette de 250 feuilles par 7	**RP120CCA4250**
Papier Color Copy Laser Haute Densité A4 - 160g	Ramette de 250 feuilles par 5	**RP160CCA4**
Papier Color Copy Laser Haute Densité A3 - 120g	Ramette de 250 feuilles par 7	**RP120CCA3250**
Papier Color Copy Laser Haute Densité A3 - 160g	Ramette de 250 feuilles par 5	**RP160CCA3**

PAPIERS COLOR COPY GLOSSY

Papiers Color Copy Glossy

Doté d'un aspect brillant, Color Copy Glossy favorise l'éclat et l'intensité des quadrichromies et valorise parfaitement les contrastes de couleurs.

- ***Aptitudes :***

Idéal pour l'impression et la reproduction couleur

- ***Garanties :***

Photocopieurs : noir et couleur
Imprimantes laser noir et couleur
Essais sur certains matériels Canon

- ***Spécifications :***

Couché moderne, brillant, 2 faces
Pâte ECF
Papier permanent garanti pour l'archivage (Iso 9706)

PAPIERS COLOR COPY GLOSSY		
Désignation	**Condt.**	**Référence**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A4 - 135 g	Ramette de 250 feuilles par 8	**RP135CCGA4**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A4 - 170 g	Ramette de 250 feuilles par 6	**RP170CCGA4**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A4 - 200 g	Ramette de 250 feuilles par 5	**RP200CCGA4**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A3 - 135 g	Ramette de 250 feuilles par 6	**RP135CCGA3**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A3 - 170 g	Ramette de 250 feuilles par 5	**RP170CCGA3**
Papier Color Copy Glossy Laser Brillant A3 - 200 g	Ramette de 250 feuilles par 4	**RP200CCGA3**

À FAIRE DÈS **RÉCEPTION...**

PROCÉDURES À LA RÉCEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

1° Lors de la livraison de votre commande, contrôlez toujours L'ETAT DE VOTRE EMBALLAGE et DE VOTRE MARCHANDISE en présence du transporteur.
Ne signez aucun document avant d'avoir fait ces contrôles.
2° En cas de difficultés avec le transporteur, contactez votre conseiller commercial au +33(0)2 48 50 88 77.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST DÉTÉRIORÉ ?

1° REFUSEZ systématiquement LE COLIS.
2° Mentionnez sur le récépissé de livraison : « MARCHANDISE REFUSÉE-COLIS ENDOMMAGÉ ».
3° Signez le récépissé et veillez à ce que le transporteur reparte avec toute la marchandise.
4° Contactez immédiatement votre conseiller commercial au +33(0)2 48 50 88 77.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST INTACT ?

1° DÉBALLEZ la marchandise EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR, vérifiez qu'elle est en bon état.
Si c'est le cas, signez le récépissé et conservez la marchandise.
2° Si la marchandise est détériorée ou si vous constatez des manques par rapport à votre commande, indiquez le, de la façon la plus précise possible, sur le bordereau de livraison.
Contactez votre conseiller commercial au +33(0)2 48 50 88 77.
3° Dans les 3 jours qui suivent la livraison, vous devez impérativement confirmer, par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, les dommages ou les manques constatés lors de la livraison.
Nous adresser dans le même temps une copie de votre courrier.

RAPPELS IMPORTANTS

1° Article L 133-3 du code de commerce :
« ***La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».***
2° En cas de doute lors d'une livraison, n'indiquez jamais sur le récépissé « Sous réserve de déballage ».
Cette mention n'a aucune valeur juridique et ne peut donner droit à quelque dédommagement que ce soit.
3° Les produits réceptionnés par vos soins, sans émission de réserves à la livraison, et sans confirmation par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, ne pourront ouvrir droit à dédommagement de la part du transporteur ou de l'expéditeur.

médiapi

Pour tout conseil, information ou devis personnalisé, contactez-nous

Par téléphone :
+33(0)2 48 50 88 77

Par fax :
+ 33(0)2 48 50 88 79

Par email :
contact@mediapi.com

Par courrier :
MEDIAPI
7 place Louis Lacombe
18000 BOURGES

Date, cachet et signature

BON DE COMMANDE

Cabinet / Docteur : .....
Etablissement : .....
Adresse : .....
.....
.....
Code postal : ..... **Ville :** .....
Contact : .....
Tél. : ..... **Fax :** .....
Email : .....

N° Client : .....

Référence	Désignation	Qté	PU HT	Prix total HT
				€
				€
				€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) PRÉAMBULE
Nos conditions de vente sont seules valables et réputées acceptées par l'acheteur. Elles sont opposables à toute condition générale d'achat. Toute clause contraire doit faire l'objet d'un accord écrit.

2) FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est formé dès réception d'une commande (téléphone, télécopie ou autre).

3) REDACTION DES COMMANDES
Nous recommandons d'utiliser les références et désignations de nos catalogues et tarifs. Si une erreur de livraison devait survenir par suite d'une imprécision, nous en déclinerions toute responsabilité; les frais de retour seraient à la charge de l'acheteur. (Voir article 8).
• Respecter le minimum de colisage lorsqu'une telle disposition est prévue
• Indiquer le mode d'expédition souhaité.
• Tous nos appareils sont fournis en 230 V-50 HZ avec prises aux normes européennes. Tension et prises différentes nous consulter.

4) DOCUMENTATION
Les illustrations du catalogue montrent les appareils et articles tels qu'ils ont été construits au moment de la publication, le vendeur se réservant le droit d'introduire toute modification ou amélioration.

5) EMBALLAGE
Les appareils sont emballés individuellement.
Les emballages ne sont pas repris.
Les expéditions sont préparées au mieux de l'intérêt de l'acheteur et lors des groupages, le matériel est mis sur palette(s).

6) EXPEDITION
S'il le désire, le délai de livraison sera notifié à l'acheteur. Il s'agit dans tous les cas, d'un délai indicatif. Il n'oblige pas le vendeur qui ne pourra en aucun cas être tenu au versement d'une quelconque indemnité si le délai annoncé ne pouvait être respecté.
Les retards de livraison éventuels ne pourront justifier l'annulation de la commande par l'acheteur.

7) MONTAGE
Pour les articles livrés démontés, le montage reste à la charge de l'acheteur et est effectué sous sa seule responsabilité, sauf accord préalable entre l'acheteur et le vendeur.

8) ASSURANCE ET TRANSPORT
• Nos marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire sans dérogation à cette clause.
• Lors de la livraison, l'acheteur, ou son réceptionnaire, est tenu de déballer la marchandise et de vérifier son bon état en présence du transporteur.
Si la marchandise est détériorée ou s'il constate des manques par rapport à la commande, l'acheteur devra l'indiquer de la façon la plus précise possible sur le bordereau de livraison qu'il remettra au transporteur.
Dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, l'acheteur devra notifier par lettre recommandée au transporteur sa réclamation détaillée.
Si cette formalité, ou toute autre prévue par l'article L 133-3 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'acheteur se trouvera privé de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.
Dans un délai de 8 jours, l'acheteur nous fera parvenir copie de sa lettre de réclamation au transporteur.
• Si l'emballage est détérioré, l'acheteur devra refuser la livraison et indiquer sur le bordereau de livraison « colis endommagé ».

9) RETOURS
• Aucun retour, sans autorisation écrite de notre part, ne sera accepté.
Le retour doit être accompagné d'un bordereau faisant référence à la facture et au bon de livraison d'origine ainsi que les motifs du retour.
• Toute reprise de matériel se fera avec une moins value de 20 % sous réserve de son état.
• Les fabrications spéciales ne sont pas reprises.

10) PRIX ET CONDITIONS
• Les ventes se font au départ de notre adresse administrative et commerciale.
• Frais de configuration et paramétrage en sus
• Fabrication spéciale : sauf accord particulier, paiement 50% à la commande, le solde aux conditions habituelles.
• TVA applicable à ce jour en France 20%.

11) PAIEMENTS
• Nos factures sont payables à notre adresse administrative et commerciale.
• Sauf stipulation contraire, nos livraisons sont payables par chèque ou virement :
- D'avance
- Contre remboursement
- 15 jours après réception de la facture
• Conformément à la LME n° 2008-776 du 04 août 2008, tout règlement effectué après l'échéance entraînera une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans que le vendeur n'effectue de formalités spécifiques.
• Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé avec AR, est considérée comme une sommation de payer.
• Les réclamations relatives à la facturation, doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception de facture. Toute facture non contestée dans ce délai sera réputée acceptée par l'acheteur.

12) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
1 - A compter de l'enlèvement de la marchandise (départ usine), la garde et les risques des marchandises sont transférés à l'acheteur.
2 - Conformément aux termes de la loi 80.355 du 12 mai 1980 nous conservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires ; jusqu'à ce moment l'acheteur aura la qualité de dépositaire des produits impayés.
3 - Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (effet de commerce ou autre).
4 - Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises.

13) GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR LES MATERIELS ET APPAREILLAGES
• Le vendeur prend la responsabilité de remédier à tous défauts de ses appareils
• Cette garantie est valable pendant une période de 1 an pour tout vice de fabrication.
La période de garantie commence à la date de livraison de la marchandise et au plus tard dans les 30 jours suivant la date contractuelle à laquelle la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur.
• Si un défaut apparaît, l'acheteur doit en informer le vendeur qui doit y remédier dans les plus brefs délais. Le vendeur se réserve la possibilité de réparer ou d'échanger le matériel à ses frais.
• En aucun cas, le vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur.
• Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions particulières spécifiées sur notre pro forma.
• En aucun cas, l'article ne sera remboursé.

14) EXPORT
Facturation H.T. départ de notre entrepôt en Euros.
Frais d'emballage en sus (Avion ou maritime à préciser).
Transport et assurance à la charge du destinataire.

15) ARBITRAGE
En cas de contestation ou de litige et quelle que soit l'importance de ceux-ci, le Tribunal de Commerce de Bourges est seul compétent.